

PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA HEALTH QUALITY

Segurança é uma questão fundamental para os profissionais de saúde envolvidos em procedimentos cirúrgicos e para os pacientes; A paramentação cirúrgica constitui-se na última barreira de proteção contra contaminações e infecções decorrentes do ato cirúrgico.

A linha de paramentação cirúrgica Health Quality foi desenvolvida com o objetivo de garantir a melhor solução técnica e financeira, adequando-se perfeitamente às exigências e requisitos técnicos, sem perder de foco e a viabilidade econômica da sua utilização.

O design dos nossos campos, aventais cirúrgicos, foi desenvolvido de maneira a garantir a técnica asséptica de sua aplicação, bem como o conforto e a ergonomia dos profissionais que os utilizam.

Os modelos de campos cirúrgicos atendem as várias especialidades cirúrgicas e técnicas de posicionamento do paciente, assim como os diferentes modelos de aventais adequam-se perfeitamente aos níveis de proteção exigidos.

A flexibilidade de nossa estrutura industrial nos permite fornecer os itens avulsos ou em forma de kit's, assim como o desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades específicas de nossos clientes.

MATÉRIAS PRIMAS

Utilizamos como matéria prima base para a confecção dos campos e aventais cirúrgicos, o SMS (não tecido), fabricado dentro de rigorosos padrões de controle de contaminação. As camadas externas são:

Spunbond: Permitem a resistência à tração e a furos.

A camada interna:

Meltblown: Constitui-se em eficiente barreira a microrganismos.

A maleabilidade e capacidade de permitir a respiração corporal proporcionam maior conforto aos usuários.

A dupla embalagem com invólucro em SMS e papel grau cirúrgico e filme plástico em três camadas de polietileno e PVC, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica de abertura asséptica.

Os adesivos utilizados são hipoalergênicos e atóxicos, assim como os materiais plásticos que garantem a impermeabilidade e resistência a impactos.

O processo de definição de parâmetros de auditoria e validação da esterilização atende às normas técnicas para a esterilização de produtos para a saúde pela tecnologia de óxido de etileno.

Desenhos do Catálogo


LEGENDA

	Laminado		Fita Adesiva
	SMS		Toalha
	Plástico		

1. AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

- Indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de pequenos volumes de sangue ou fluidos corpóreos.
- Confeccionado em Não Tecido SMS de 50g/m² “tipo opa” - Azul.
- Repelente a Líquidos e fluidos corporais.
- Mangas longas anatômicas do tipo Raglan, solda ultrassônica, com punho de malha que conferem maior conforto e segurança ao Profissional.
- Tiras para fechamento interno.
- Fechamento nas costas ajustável com fecho tipo Velcro;
- Cartão de transferência asséptica (TAG).
- Cada avental acompanha 1 toalha absorvente para as mãos.
- Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica
- Quatro diferentes tamanhos que vestem com maior conforto:
 - Tamanho P - Altura 110 cm - Largura: 150 cm.
 - Tamanho G - Altura 120 cm - Largura: 160 cm.
 - Tamanho XG - Altura 135 cm - Largura: 175 cm.
 - Tamanho XXG – Altura 145 cm - Largura: 190 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227019	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL P – 50G	40
227013	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL G – 50G	44
227017	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL XG – 50G	38
227023	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL XXG – 50G	32

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330054
-----------------------------	---------------------------	--

2. AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL IMPERMEÁVEL

Indicação de Uso:

- Indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de grandes volumes de sangue ou fluidos corpóreos.
- Confeccionado em Não Tecido SMS de 50g/m² “tipo opa” - Azul.
- Impermeável a Líquidos e fluidos corporais.
- Película Impermeável nos braços, tórax e abdômen.
- Mangas longas anatômicas do tipo Raglan, solda ultrassônica, com punho de malha que conferem maior conforto e segurança ao Profissional.
- Tiras para fechamento interno.
- Fechamento nas costas ajustável com fecho tipo Velcro;
- Cartão de transferência asséptica (TAG).
- Cada avental acompanha 1 toalha absorvente para as mãos.
- Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica
- Três diferentes tamanhos que vestem com maior conforto:
 - Tamanho G - Altura 120 cm - Largura: 160 cm.
 - Tamanho XG - Altura 135 cm - Largura: 175 cm.
 - Tamanho XXG – Altura 145 cm - Largura: 190 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227016	AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL ESTÉRIL G - 50G	40
227018	AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL ESTÉRIL XG – 50G	36
227027	AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL ESTÉRIL XXG – 50G	30

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330054
-----------------------------	---------------------------	--

3. AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL STD

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de moderados volumes de sangue ou fluídos corpóreos.

- Confeccionado em Não Tecido SMS - Azul
- Repelente a Líquidos e fluidos corporais
- Tiras para fechamento interno
- Fechamento nas costas ajustável com fecho tipo Tira ou Velcro.
- Cartão de transferência asséptica (TAG)
- Mangas com Solda Ultrassônica.
- Cada avental acompanha 1 toalha absorvente para as mãos
- Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica
- Dois diferentes tamanhos que vestem com maior conforto:
 - Tamanho G - Altura 120 cm - Largura: 155 cm – 40g/m² - Manga Raglan
 - Tamanho XG - Altura 130 cm - Largura: 160 cm – 40g/m² - Manga Raglan



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
227014	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL STD G – 40G	48
227033	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL STD XG – 40G	48

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330054
-----------------------------	---------------------------	--

4. AVENTAL CIRÚRGICO STD IMPERMEÁVEL ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de moderados volumes de sangue ou fluídos corpóreos.

- Confeccionado em Não Tecido SMS - Azul
- Repelente a Líquidos e fluidos corporais
- Película Impermeável nos braços, tórax e abdômen
- Tiras para fechamento interno.
- Fechamento nas costas ajustável com fecho tipo Tira ou Velcro.
- Cartão de transferência asséptica (TAG)
- Mangas com Solda Ultrassônica.
- Cada avental acompanha 1 toalha absorvente para as mãos
- Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica
- Dois diferentes tamanhos que vestem com maior conforto:
 - Tamanho G - Altura 120 cm - Largura: 155 cm – 40g/m² - Manga Raglan
 - Tamanho XG - Altura 130 cm - Largura: 160 cm – 40g/m² - Manga Raglan



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227037	AVENTAL CIRÚRGICO STD IMPERMEÁVEL ESTÉRIL G – 40G	44
227034	AVENTAL CIRÚRGICO STD IMPERMEÁVEL ESTÉRIL XG – 40G	40

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330054
-----------------------------	---------------------------	--

5. AVENTAL PARA PROCEDIMENTO LAMINADO

COM ELÁSTICO E FIXADOR (não estéril)

CA – 31.261

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessário o uso de vestimenta impermeável e respirável não estéril.

- Confeccionado em Não Tecido laminado respirável 50g/m² - Branco
- Repelente a líquidos e fluidos corporais
- Mangas retas soldas ultrassônica com punho elástico e fixador
- Vestir pela cabeça
- Fechamento ajustável em tiras nas costas
- Tiras Laterais
- Medida 130 cm x 85 cm - Tamanho: XG



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
227004	AVENTAL P/ PROCEDIMENTO C/ ELÁSTICO E FIXADOR	25			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização N/E</td><td>Validade 3 anos</td><td>Notificação ANVISA 80166330040</td></tr> </table>			Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040
Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040			

6. AVENTAL PARA PROCEDIMENTO LAMINADO

COM PUNHO DE MALHA (não estéril)

CA – 31.261

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessário o uso de vestimenta impermeável e respirável não estéril.

- Confeccionado em Não Tecido laminado respirável 50g/m² - Branco
- Impermeável a líquidos e fluidos corporais
- **Reforço laminado no tórax e mangas.**
- Mangas retas solda ultrassônica com punho de malha.
- Veste pela cabeça
- Fechamento ajustável em tiras nas costas
- Tiras Laterais
- Medida 130 cm x 85 cm – Tamanho: XG



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
227020	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO C/ PUNHO DE MALHA	25			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização N/E</td><td>Validade 3 anos</td><td>Notificação ANVISA 80166330040</td></tr> </table>			Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040
Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040			


7. AVENTAL PARA PROCEDIMENTO LAMINADO

(não estéril)

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessário o uso de vestimenta impermeável não estéril.

- Confeccionado em Não Tecido laminado respirável 50g/m² - Branco
- Impermeável a líquidos e fluidos corporais
- Mangas Raglan solda ultrassônica e punho em malha de algodão.
- Fechamento ajustável em tiras nas costas e tiras na altura do pescoço.
- Tiras Laterais
- Medida 120 cm x 160 cm – Tamanho G

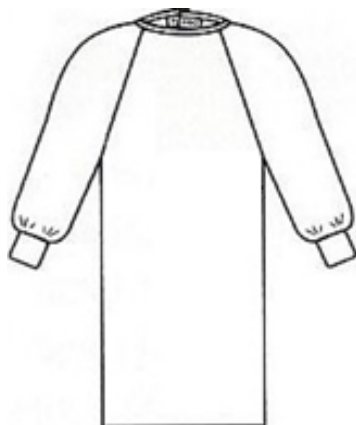

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227005	AVENTAL PARA PROC. LAMINADO BRANCO MANGA RAGLAN	25

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040
-----------------------------	---------------------------	--

8. AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM SMS E


LAMINADO (não estéril)

CA- 35.503

Indicação de Uso:

Indicado para proteção parcial do corpo e das roupas, dos profissionais que trabalham em serviços de saúde, no atendimento ao paciente ou no desenvolvimento de outras atividades em que exista risco eminente de contaminação, por acidentes com respingo ou jatos moderados de produtos químicos.

- Confeccionado em SMS na região das costas 50g/m²- cor Azul.
- Laminado Impermeável na região frontal e braços 48g/m² - cor Azul.
- Impermeável a líquidos e fluidos corporais.
- Mangas longas raglan soldadas e punhos em malha.
- Fechamento ajustável em tiras no pescoço.
- Tiras laterais para amarração na cintura – 90 cm.
- Medida: 120 cm x 160 cm.

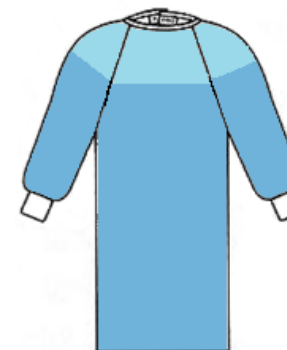

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227006	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM SMS E LAMINADO	20


Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040
-----------------------------	---------------------------	--

9. AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM LAMINADO (não estéril)

Indicação de Uso:

Indicado para proteção parcial do corpo e das roupas, dos profissionais que trabalham em serviços de saúde, no atendimento ao paciente ou no desenvolvimento de outras atividades em que exista risco eminente de contaminação, por acidentes com respingo ou jatos moderados de produtos químicos.

- Confeccionado em Laminado Impermeável 48g/m²- cor Azul.
- Impermeável a líquidos e fluidos corporais.
- Mangas longas raglan soldadas e punhos em malha.
- Fechamento ajustável em tiras no pescoço.
- Tiras laterais para amarração na cintura – 90 cm.
- Medida: 130 ± 5 cm x 150 cm.

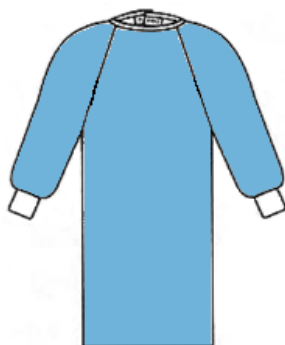

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227039	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO LAMINADO AZUL	60

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040
-----------------------------	---------------------------	--

10. AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM SMS C/ REFORÇO C/ 10 UNIDADES (não estéril)

Indicação de Uso:

Indicado para proteção parcial do corpo e das roupas, dos profissionais que trabalham em serviços de saúde, no atendimento ao paciente ou no desenvolvimento de outras atividades em que exista risco eminente de contaminação, por acidentes com respingo ou jatos moderados de produtos químicos.

- Confeccionado em SMS 40g/m², na cor azul.
- Repelente a líquidos e fluidos corporais.
- Possui película impermeável 26g/m² nos braços, tórax e abdômen.
- Mangas longas do tipo raglan, soldadas ultrassonicamente e com punho de malha.
- Fechamento ajustável em tiras no pescoço, e duas tiras laterais em SMS para amarração na cintura.
- Medida: 120 cm x 160 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227040	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM SMS COM REFORÇO C/ 10 UN	5

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330040
-----------------------------	---------------------------	--

11. AVENTAL PACIENTE AZUL ESCURO C/ 10**UNIDADES (não estéril)****Indicação de Uso:**

Indicado para utilização do paciente em procedimentos médicos e laboratoriais.

- Confeccionado em SMS 100% Polipropileno - cor Azul
- Sem mangas, transpassado na frente
- 02 Tiras Laterais ajustáveis à cintura
- Medida 120 cm x 160 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227009	AVENTAL PACIENTE AZUL ESCURO C/ 10 UNIDADES	03

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330038
-----------------------------	---------------------------	--

12. AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO COM MANGAS (não estéril).**Indicação de Uso:**

Indicado para proteção, dos profissionais que trabalham em serviços de saúde, no atendimento ao paciente ou no desenvolvimento de outras atividades em que exista risco eminente de contaminação, por acidentes com respingo ou jatos moderados de produtos químicos.

- Confeccionado em Filme de PE Laminado 30g/m² - Cor Branca.
- Impermeável a líquidos e fluidos corporais.
- Possui mangas longas retas, com punho em elástico.
- Fechamento ajustável em tiras no pescoço.
- Duas tiras laterais do mesmo material para amarração na cintura.
- Medida: 115 cm de Altura x 140 cm de Largura.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
227041	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO COM MANGAS	150
227042	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO COM MANGAS C/ 10 UNIDADES	12

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330038
-----------------------------	---------------------------	--

13. MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO C/ 50 UNIDADES

Indicação de Uso:

Equipamento de proteção de uso único, destinado a cobrir a boca e o nariz; indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger o profissional de saúde de agentes contaminantes provenientes do paciente, devendo também impedir a passagem de sangue e outros fluidos corpóreos e minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional de saúde ou paciente.

- Confeccionada em 3 camadas, livre de odores, sendo as camadas interna e externa confeccionadas em não tecido spundond (TNT) branco 15g/m², e a camada do meio com elemento filtrante em tecido não tecido 100% polipropileno 40g/m² resistente a fluidos e partículas transportados do ar.
- Produto de uso individual, na cor branca possuindo elástico para fixação atrás das orelhas.
- Clipe nasal maleável de alumínio que tem como função manter o contorno de nariz e das bochechas.
- Medidas: Corpo da Máscara: 175 mm x 90 mm. Clipe Nasal: 130 mm; Elásticos: 100 mm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
218001	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO C/ 50 UN	56

Esterilização N/E	Validade 5 anos	Notificação ANVISA 80166330077
-----------------------------	---------------------------	--

14. MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ TIRAS C/ 50 UNIDADES

Indicação de Uso:

Equipamento de proteção de uso único, destinado a cobrir a boca e o nariz; indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger o profissional de saúde de agentes contaminantes provenientes do paciente, devendo também impedir a passagem de sangue e outros fluidos corpóreos e minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional de saúde ou paciente.

- Confeccionada em 3 camadas, livre de odores, sendo as camadas interna e externa confeccionadas em não tecido spundond (TNT) branco 15g/m², e a camada do meio com elemento filtrante em tecido não tecido 100% polipropileno 40g/m² resistente a fluidos e partículas transportados do ar.
- Produto de uso individual, na cor branca possuindo tiras para amarração sobre a touca, na cabeça.
- Clipe nasal maleável de alumínio que tem como função manter o contorno de nariz e das bochechas.
- Medidas: Corpo da Máscara: 175 mm x 90 mm. Clipe Nasal: 130 mm; Tiras: 800 mm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
218004	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ TIRAS C/ 50 UN	24

Esterilização N/E	Validade 5 anos	Notificação ANVISA 80166330077
-----------------------------	---------------------------	--

15. RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VÁLVULA C.A – 45.227

Indicação de Uso:

O Respirador PFF-2 (S) é indicado para proteção das vias respiratórias, contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.

- Respirador semifacial descartável, classe PFF-2 (S), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado em 3 camadas, sendo elas: Um filtro com tratamento eletrostático 60g/m² juntamente com uma lâmina em TNT, não tecido esturante 100g/m² e TNT 40g/m² na parte externa.
- Possui clipe nasal que facilita a vedação e tirante elástico para fixação na cabeça.
- Produto repelente a água (hidrofóbico), na cor branca.
- Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.
- Isento de fibra de vidro, hipoalergênica e livre de odores.
- Produto fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 14873:2002.
- Embalado individualmente em embalagem plástica.
- Medidas: Altura: 16 cm x Largura: 12 cm x Elástico: 80 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
299197	RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VÁLVULA	50			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização N/E</td><td>Validade 3 anos</td><td>Notificação ANVISA 80166330082</td></tr> </table>			Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330082
Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330082			

16. RESPIRADOR PFF-2 (S) COM VÁLVULA C.A – 45.226

Indicação de Uso:

O Respirador PFF-2 (S) é indicado para proteção das vias respiratórias, contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.

- Respirador semifacial descartável, classe PFF-2 (S), modelo dobrável, com válvula de exalação, formado em 3 camadas, sendo elas: Um filtro com tratamento eletrostático 60g/m² juntamente com uma lâmina em TNT, não tecido esturante 100g/m² e TNT 40g/m² na parte externa.
- Possui clipe nasal que facilita a vedação e tirante elástico para fixação na cabeça.
- Produto repelente a água (hidrofóbico), na cor branca.
- Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.
- Isento de fibra de vidro, hipoalergênica e livre de odores.
- Produto fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 14873:2002.
- Embalado individualmente em embalagem plástica.
- Medidas: Altura: 16 cm x Largura: 12 cm x Elástico: 80 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
299204	RESPIRADOR PFF-2 (S) COM VÁLVULA	35			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização N/E</td><td>Validade 3 anos</td><td>Notificação ANVISA 80166330082</td></tr> </table>			Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330082
Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330082			

17. CAMPO CIRÚRGICO SMS FENESTRADO ESTÉRIL SEM REFORÇO E SEM ADESIVO

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- Campo Cirúrgico confeccionado em Não Tecido SMS - Azul.
- Fenestra circular.
- Dobra asséptica.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.



Obs. Código 225166 com fenestra e abertura.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225099	CAMPO CIR. SMS FENEST. 08CM ESTÉRIL 30CM X 30CM – 40g/m²	400
225096	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM ESTÉRIL 40CM X 40CM – 40g/m²	250
225181	CAMPO CIR. SMS FENEST. 06CM ESTÉRIL 50CM X 50CM – 50g/m²	150
225187	CAMPO CIR. SMS FENEST. 08CM ESTÉRIL 50CM X 50CM – 40g/m²	150
225100	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM ESTÉRIL 50CM X 50CM – 40g/m²	150
225165	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM ESTÉRIL 60CM X 60CM – 40g/m²	150
225195	CAMPO CIR. SMS FENEST. 08CM ESTÉRIL 75CM X 75CM – 40g/m²	120
225171	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM ESTÉRIL 75CM X 75CM – 40g/m²	100
225182	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM ESTÉRIL 80CM X 80CM – 40g/m²	100
225083	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM ESTÉRIL 220CM X 160CM – 40g/m²	20
225166	CAMPO CIR. SMS FEN. 10CM VESICAL EST. 75CM X 75CM – 40g/m²	100


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330053
-----------------------------	---------------------------	--

18. CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL SMS COM ADESIVO SEM REFORÇO

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- Campo Cirúrgico confeccionado em Não Tecido SMS - Azul.
- Fenestra com fita adesiva hipoalergênica.
- Dobra asséptica.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.

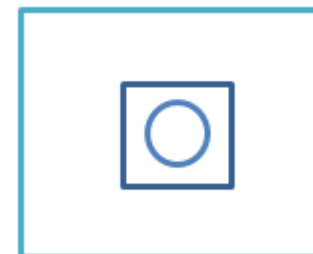

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225052	CAMPO CIR. SMS FEN. 06CM C/ADESIVO EST 40CM X 40CM - 40g/m²	200
225054	CAMPO CIR. SMS FEN. 10CM C/ADESIVO EST. 50CM X 50CM - 40g/m²	150
225055	CAMPO CIR. SMS FEN. 10CM C/ADESIVO EST. 60CM X 60CM - 40g/m²	100
225207	CAMPO CIR. SMS FEN. 08CM C/ADESIVO EST. 75CM X 75CM - 40g/m²	100
225057	CAMPO CIR. SMS FEN. 10CM C/ADESIVO EST. 80CM X 80CM - 40g/m²	100
225058	CAMPO CIR. SMS FEN. 10CM C/ADESIVO EST. 90CM X 90CM - 40g/m²	50
225161	CAMPO CIR. SMS FEN. 10CM C/ADESIVO EST. 100CM X 100CM 40g/m²	50


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330050
-----------------------------	---------------------------	--

19. CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO COM REFORÇO E ADESIVO

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- Campo Cirúrgico confeccionado em Não Tecido SMS – Azul
- Fenestra com fita adesiva hipoalergênica
- Reforço absorvente próximo da área incisional
- Dobra asséptica
- Dupla embalagem em invólucro SMS 25g/m² e Papel Grau Cirúrgico.

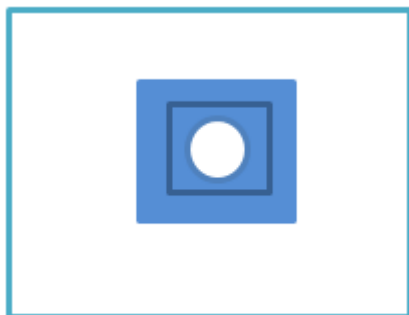

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225145	CAMPO CIR. FENEST. 8CM C/REFORÇO ESTERIL 120 X 160 CM - 50g/m ²	25
225106	CAMPO CIR. SMS FENEST. 10CM C/REFOR. EST. 150CMX 160 CM - 40g/m ²	64
225159	CAMPO CIR. ESTÉRIL FENEST. 16CM GRANDE 200CM X 300 CM - 50g/m ²	08

Esterilização
ETO

Validade
3 anos


Notificação ANVISA
80166330051

20. CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- Campo Cirúrgico Confeccionado em Não Tecido SMS – Azul
- Dobra asséptica
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225090	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 30CM X 30CM - 40g/m ²	400
225186	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 40CM X 40 CM - 40g/m ²	600
225128	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 50CM X 50 CM - 40g/m ²	150
225091	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 60CM X 60CM - 40g/m ²	150
225184	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 75CM X 75 CM - 40g/m ²	100
225183	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 80CM X 80 CM - 40g/m ²	100
225201	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 90CM X 90CM - 40g/m ²	70
225149	CAMPO CIRÚRGICO SMS SIMPLES ESTÉRIL 140CM X 160CM - 50g/m ²	25

Esterilização
ETO

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
80166330053

21. CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- Campo Cirúrgico confeccionado em Não Tecido SMS 50g/m² – Azul.
- Dobra asséptica.
- Dupla embalagem em invólucro em SMS 25g/m² e Papel Grau Cirúrgico.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225168	CAMPO CIR. SMS ESTÉRIL PEQUENO 110 CM X 160 CM	30
225170	CAMPO CIR. SMS ESTÉRIL MÉDIO 110 CM X 200 CM	25
225173	CAMPO CIR. SMS ESTÉRIL GRANDE 160 CM X 200 CM	20

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330053
----------------------	--------------------	-----------------------------------

22. CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS COM REFORÇO E ADESIVO

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- Campo Cirúrgico confeccionado em Não Tecido SMS – Azul.
- Reforço absorvente 55g/m², próximo à área cirúrgica.
- Fita adesiva hipoalergênica na borda do campo.
- Dobra asséptica.
- Dupla embalagem em invólucro em SMS 25g/m² e Papel Grau Cirúrgico.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225189	CAMPO CIR. SMS C/ REFOR. E FITA ADES. EST. 160 CM X 160 CM - 50g/m ²	20
225023	CAMPO CIR. SMS C/ REFOR. E FITA ADES. EST. 160 CM X 200 CM - 40g/m ²	15


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051
----------------------	--------------------	-----------------------------------

23. CAMPO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO FENESTRADO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos pediátricos onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e o isolamento da área a ser tratada.

- 01 – Campo Cirúrgico em SMS com reforço impermeável 55g/m², com fenestra de 10 cm e fita adesiva hipoalergênica.
- Apresentam-se em duas gramaturas e medidas diferentes:
 - Campo em SMS 40g/m² na medida de 160 cm x 270 cm.
 - Campo em SMS 50g/m² na medida de 160 cm x 170 cm.
- Dupla embalagem em invólucro em SMS 25g/m² e Papel Grau Cirúrgico.

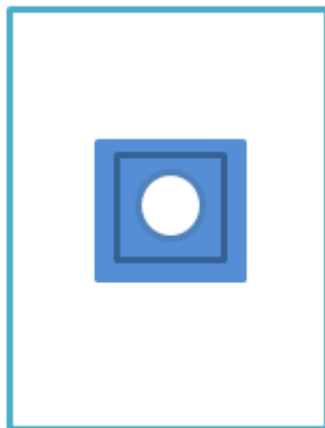

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225175	CAMPO CIR. ESTÉRIL FENEST. 10CM PEDIÁTRICO 160 X 170 CM - 50g/m ²	20
225160	CAMPO CIR. ESTÉRIL FENEST. 10CM PEDIÁTRICO 160 X 270 CM - 40g/m ²	16


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051
-----------------------------	---------------------------	--

24. CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO PARA MAMA COM REFORÇO E ADESIVO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

O Campo Cirúrgico Fenestrado para Mama c/ Reforço e Adesivo é destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos, tanto para o cirurgião como para o paciente. Indicado para procedimentos cirúrgicos de mastologia e prótese mamária.

- 01 – Campo Impermeável de Mesa confeccionado em laminado 48gm² de 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mama confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 300 cm com fenestras retangular na medida de 20 cm x 40 cm, com reforço em laminado impermeável 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica ao redor de toda a fenestra.

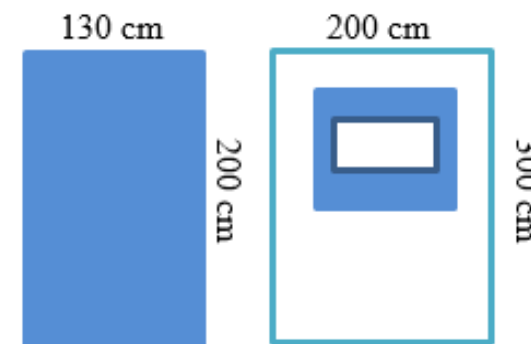

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225259	CAMPO CIR. FENEST. PARA MAMA C/ REFORÇO E ADESIVO ESTÉRIL	15


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051
-----------------------------	---------------------------	--

25. CAMPO IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR COM REFORÇO

Indicação de Uso:

Indicado para cobertura impermeável de mesas cirúrgicas auxiliares.

- Campo confeccionado em filme de polietileno 60g/m² de alta resistência a impactos – Azul.
- Reforço em SMS 24g/m²
- Dobra que garante a manutenção da técnica asséptica na abertura.
- Embalagem simples ou dupla em invólucro SMS 25g/m², conforme informação na tabela abaixo.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225027	CAMPO CIR. MESA AUX. ESTÉRIL C/ REFORÇO 140CM X 180 CM (SIMPLES EMBALAGEM)	30
225028	CAMPO CIR. MESA AUX. ESTÉRIL C/ REFORÇO 140 CM X 200 CM (SIMPLES EMBALAGEM)	30
225022	CAMPO CIR. MESA AUX. ESTERIL C/ REFORÇO 140CM X 230CM (SIMPLES EMBALAGEM)	25
225029	CAMPO CIR. MESA AUX. ESTERIL C/ REFORÇO 140CM X 220 CM (DUPLA EMBALAGEM)	30

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330018
-----------------------------	---------------------------	--

26. CAMPO PARA MESA AUXILIAR LAMINADO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para cobertura impermeável de mesas cirúrgicas auxiliares.

- Campo confeccionado em Não Tecido laminado 48g/m² com filme de polietileno impermeável de alta resistência – Azul.
- Dobra que garante a manutenção da técnica asséptica na abertura.
- Embalagem simples ou dupla em invólucro SMS 25g/m², conforme informação na tabela abaixo.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225024	CAMPO CIR. SMS LAMINADO ESTÉRIL 80 CM X 65 CM (SIMPLES EMBALAGEM)	100
225129	CAMPO CIR. SMS LAMINADO ESTÉRIL 80CM X 140 CM (SIMPLES EMBALAGEM)	50
225130	CAMPO CIR. SMS LAMINADO ESTÉRIL 140CM X 160 CM (SIMPLES EMBALAGEM)	30
225206	CAMPO CIR. MESA AUX. SMS LAMINADO STD ESTÉRIL 130CM X 200CM (SIMPLES EMBALAGEM)	80
225088	CAMPO CIR. MESA AUX. SMS LAMINADO ESTÉRIL 100CM X 140CM (DUPLA EMBALAGEM)	45
225123	CAMPO CIR. MESA AUX. SMS LAMINADO ESTÉRIL 130CM X 200 CM (DUPLA EMBALAGEM)	75


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330053
-----------------------------	---------------------------	--

27. CAMPO PARA MESA AUXILIAR PLÁSTICO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para cobertura impermeável de mesas cirúrgicas auxiliares.

- Campo confeccionado em filme de polietileno 60g/m² de alta resistência a impactos – Azul.
- Dobra que garante a manutenção da técnica asséptica na abertura.
- Medida: 100 cm x 140 cm.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225101	CAMPO CIR. P/ MESA AUX. PLÁSTICO ESTÉRIL 100 CM X 140 CM	50


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330053
-----------------------------	---------------------------	--

28. CAMPO DE MESA AUXÍLIAR ESTÉRIL LAMINADO “TIPO VARAL” 180 CM X 200 CM

Indicação de Uso:

Usado em cirurgias em geral de forma a auxiliar no isolamento da mesa de instrumental cirúrgico, evitando a passagem de sangue e outros fluídos protegendo os pacientes de uma possível contaminação bacteriana durante a realização de procedimentos cirúrgicos.

- Campo confeccionado em Laminado Impermeável 48g/m², com reforço impermeável 55g/m² e
- Reforço na região das janelas: medindo 180 cm x 200 cm
- 13 janelas de 2 cm, e distância de 9 cm entre elas.

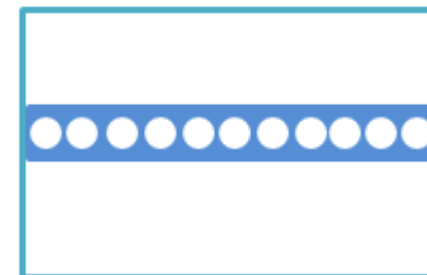

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225193	CAMPO CIR. MESA AUX. SMS LAM. VARAL ESTÉRIL 180 CM X 200CM	20

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330018
-----------------------------	---------------------------	--

29. CAMPO PARA COBERTURA DE MESA DE MAYO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para cobertura impermeável de mesas cirúrgicas auxiliares do tipo Mayo.

- Confeccionado em lâmina de polietileno de alta resistência a impactos medindo 60 cm x 135 cm, com reforço e tiras para amarração.
- Dobrado em formato de fronha /envelope que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225032	CAMPO CIR. P/ MESA DE MAYO ESTÉRIL	70
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330018		

30. CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL PARA INSTRUMENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para o acondicionamento de instrumentos cirúrgicos.

- Campos confeccionados em SMS 50g/m², com fita adesiva na extremidade superior para fixação no campo cirúrgico.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.
- Apresenta-se em 3 diferentes tamanhos.

TAMANHO	ALTURA	LARGURA	DIVISOES
Pequeno	30 cm	35 cm	6 de 5,0 cm
Médio	30 cm	35 cm	4 de 7,0 cm
Grande	40 cm	50 cm	4 de 11 cm




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
299151	CAMPO CIRÚRGICO PARA INSTRUMENTAL P ESTÉRIL	200
299056	CAMPO CIRÚRGICO PARA INSTRUMENTAL M ESTÉRIL	200
299147	CAMPO CIRÚRGICO PARA INSTRUMENTAL G ESTÉRIL	70
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330050		

31. CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL LAMINADO PARA ANGIOPLASTIA

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e comandos dos equipamentos.

- 01 – Campo Cirúrgico para Angioplastia confeccionado em Laminado Não Tecido 48g/m² na medida de 240 cm x 350 cm e duas janelas de Plástico Liso transparente 0,05 mm de espessura na medida de 70 cm x 350 cm, possui 3 fenestras, sendo duas de 10 cm de diâmetro (femoral) e uma de 8 cm de diâmetro (radial), com adesivo hipoalergênico.
- Dupla embalagem em Invólucro Plástico e Papel Grau Cirúrgico.

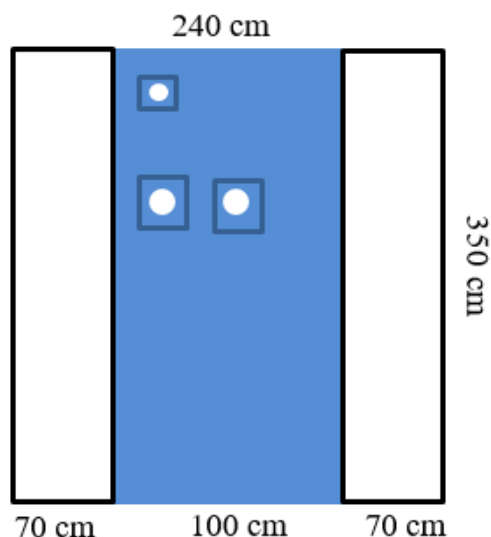

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225020	CAMPO CIR. SMS LAMINADO P/ ANGIOPLASTIA ESTÉRIL	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330050
-----------------------------	---------------------------	--

32. KIT HEMODINÂMICA FEMORAL/RADIAL COM CAMPO APROXIMAÇÃO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de angiografia e/ou angioplastia com abordagens femoral ou radial proporcionando uma região isolada e livre de partículas e líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 230 cm x 350 cm, com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², duas fenestras de 10 cm, com adesivo hipoalergênico, uma janela plástica transparente na medida de 70 cm x 350 cm e com bolsa lateral coletora de fluidos.
- 01 – Campo Cirúrgico Laminado para aproximação 48g/m² na medida de 80 cm x 120 cm, fenestrado em “U” (medida de 10 cm x 15 cm) com fita adesiva hipoalergênica. (para acesso radial)
- 01 – Campo Cirúrgico Simples em SMS 50g/m² na medida de 100 cm x 100 cm para isolamento do suporte de soro.
- 01 – Embalagem Plástica Capa Protetora para Intensificador
- 01 – Luva para isolamento da mão no procedimento radial.
- 02 – Toalhas absorventes na medida de 39 cm x 50 cm

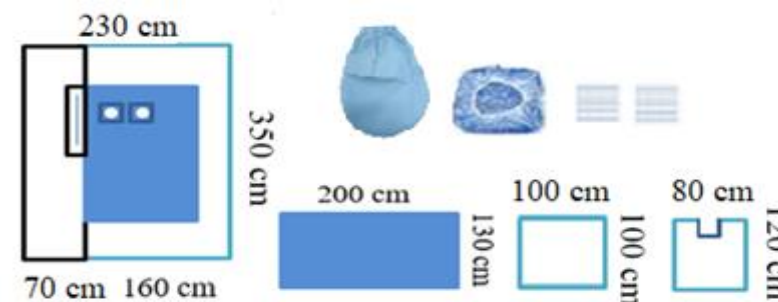

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225194	KIT HEM. FEMORAL/RADIAL C/ CAMPO APROX. ESTÉRIL	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
-----------------------------	---------------------------	--

33. KIT HEMODINÂMICA / ANGIOGRAFIA FEMORAL ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de angiografia e/ou angioplastia com abordagens femoral ou radial proporcionando uma região isolada e livre de partículas e líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 230 cm x 350 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², duas janelas de 10 cm de diâmetro com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm e bolsa lateral coletora de fluidos.
- 01 - Embalagem Plástica Capa Protetora para Intensificador - Tamanho GG - Medida: 60 cm x 120 cm.

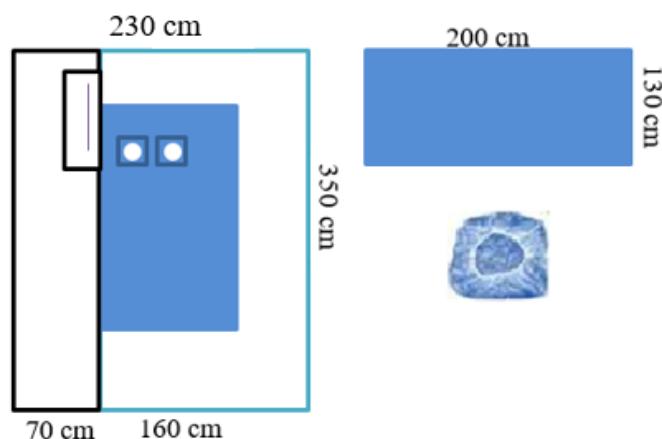

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225196	KIT HEMODINÂMICA / ANGIOGRAFIA FEMORAL ESTÉRIL	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
-----------------------------	---------------------------	--

34. KIT HEMODINÂMICA DESCARTAVEL ESTÉRIL I FEMORAL/RADIAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e comandos dos equipamentos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 230 cm x 350 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com 03 janelas circulares, sendo duas de 10 cm de diâmetro (femoral) e uma de 08 cm de diâmetro (radial) com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm.
- 01 - Embalagem Plástica Capa Protetora para Intensificador - Tamanho G - Medida: 60 cm x 110 cm.

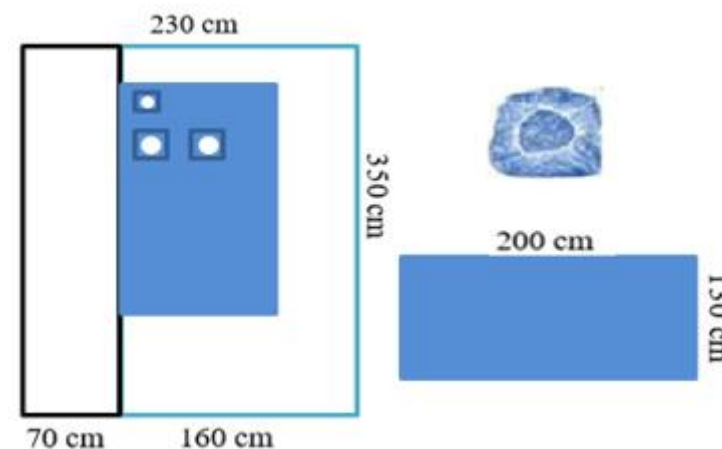

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222123	KIT HEMODINÂMICA DESCARTAVEL ESTÉRIL I	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
-----------------------------	---------------------------	--

35. KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL II FEMORAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via femoral, para isolamento do paciente e para isolamento dos comandos do equipamento.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 230 cm x 350 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com duas fenestras circulares de 10 cm de diâmetro cada, com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm e bolsa lateral coletora de fluidos.
- 01- Embalagem Plástica Capa Protetora para Intensificador – Tamanho GG - Medida 60 cm x 120 cm.
- 01 – Embalagem Plástica para Biombo – Medida: 80 cm x 120 cm.
- 01 – Luva para isolamento da mão no procedimento radial
- 02 – Toalhas Absorventes 39 cm x 50 cm.

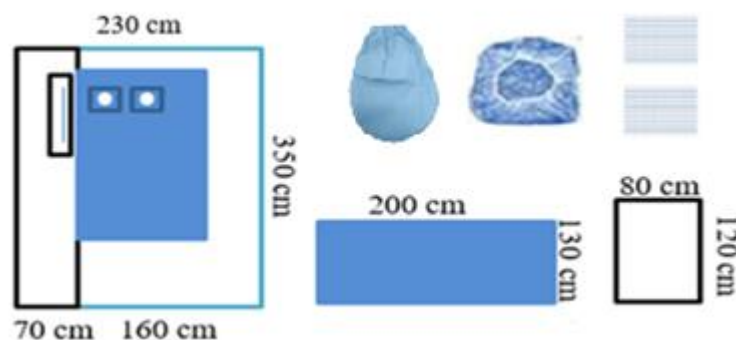

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
22212	KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL II	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
-----------------------------	---------------------------	--

36. KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL III FEMORAL/RADIAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e dos comandos do equipamento.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado Laminado Não Tecido 48g/m² na medida de 170 cm x 320 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com três fenestras circulares sendo duas de 10 cm de diâmetro cada (femoral) e uma de 06 cm de diâmetro (radial), com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 320 cm.
- 01 – Embalagem Plástica Capa Protetora para Intensificador - Medida: 35 cm x 70 cm

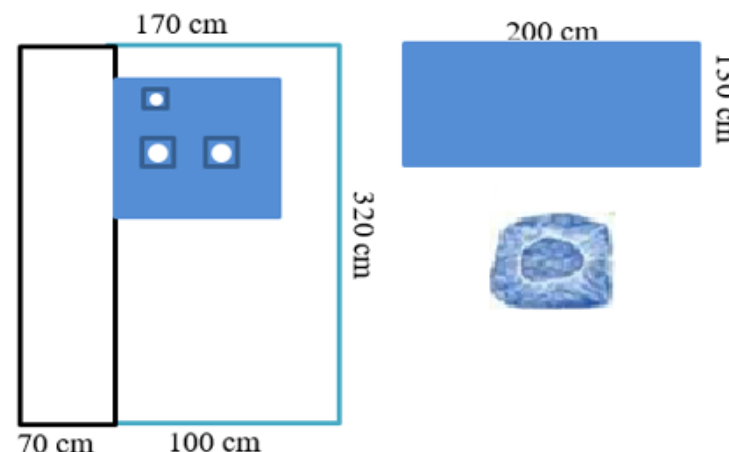

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222165	KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL III	24


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
-----------------------------	---------------------------	--

37. KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL III C/ CAMPO SIMPLES

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e para isolamento dos comandos do equipamento.

- 01 - Campo Impermeável de Mesa em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 160 cm x 350 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com três fenestras circulares sendo duas de 10 cm de diâmetro cada (femoral) e uma de 06 cm de diâmetro (radial), com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm.
- 01 - Capa protetora de Equipamento 60 cm x 110 cm.
- 01 - Luva para isolamento da mão no procedimento radial;
- 01 - Campo Cirúrgico SMS Simples confeccionado em SMS 40g/m² na medida de 100 cm x 100 cm.

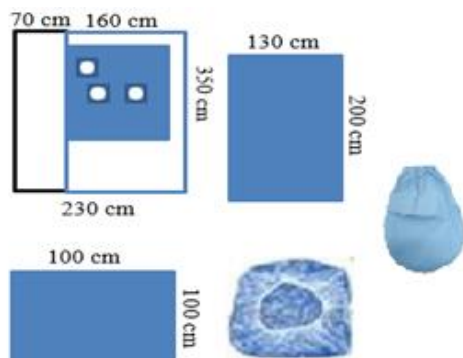

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222249	KIT HEMODINÂMICA DESC. ESTÉRIL III C/ CAMPO SIMPLES	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
----------------------	--------------------	-----------------------------------

38. KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL IV C/ AVENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e para isolamento dos comandos do equipamento.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm
- 01 - Avental Cirúrgico Estéril G – Tamanho: 120 cm x 160 cm
- 01 - Toalha Absorvente
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 230 cm x 350 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com três fenestras circulares sendo duas 10 cm de diâmetro (femoral) e uma de 08 cm de diâmetro (radial), com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm.
- 01 - Embalagem Plástica Capa Protetora para Intensificador – Tamanho G - Medida 60 cm x 110 cm

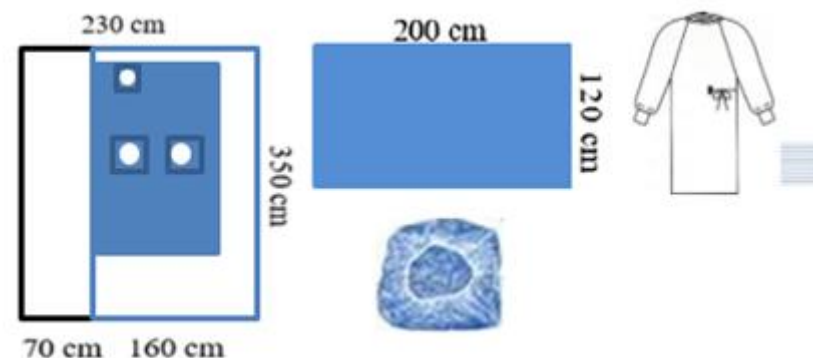

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222180	KIT HEMODINÂMICA DESC. ESTÉRIL IV C/ AVENTAL	09


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330046
----------------------	--------------------	-----------------------------------

39. KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL V

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e dos comandos do equipamento.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em laminado 48g/m² na medida de 240 cm x 350 cm, com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com três fenestras circulares, sendo duas de 10 cm de diâmetro (femoral) e uma com 08 cm de diâmetro (radial), com adesivo hipoalergênico e duas janelas de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm.
- 01 - Embalagem Plástica Capa Protetora para Itensificador - Tamanho G - Medida: 60 cm x 110 cm.

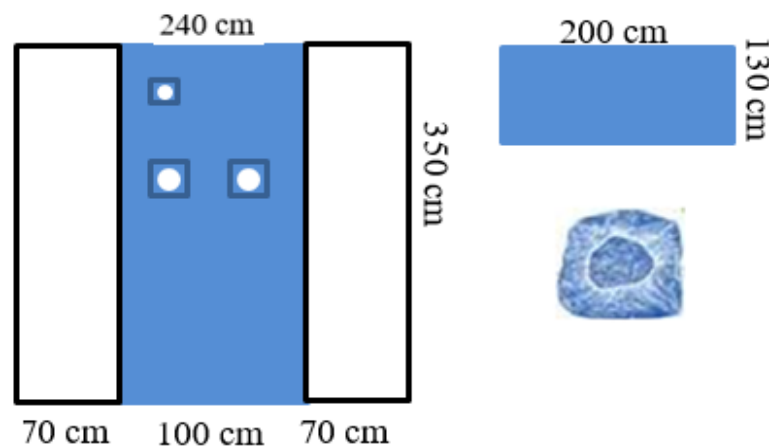


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222188	KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL V	24
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330046		

40. KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL VI C/ 3 AVENTAIS

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica via femoral, para isolamento do paciente e dos comandos do equipamento.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm
- 02 - Aventais Cirúrgicos Estéril Impermeáveis - Tamanho XG - Medida: 135 cm x 175 cm
- 01 - Aventais Cirúrgico Estéril - Tamanho XG - Medida: 135 cm x 175 cm
- 03 - Toalhas Absorventes
- 01 - Campo Cirúrgico para Hemodinâmica confeccionado em polipropileno - SMS 50g/m² na medida de 230 cm x 350 cm com reforço impermeável e adsorvente 55g/m², com duas fenestras circulares (femorais) de 10 cm cada com adesivo hipoalergênico e uma janela de plástico liso transparente na medida de 70 cm x 350 cm.
- 03 - Campos Cirúrgicos Simples confeccionado em polipropileno - SMS 50g/m² na medida de 75 cm x 75 cm.

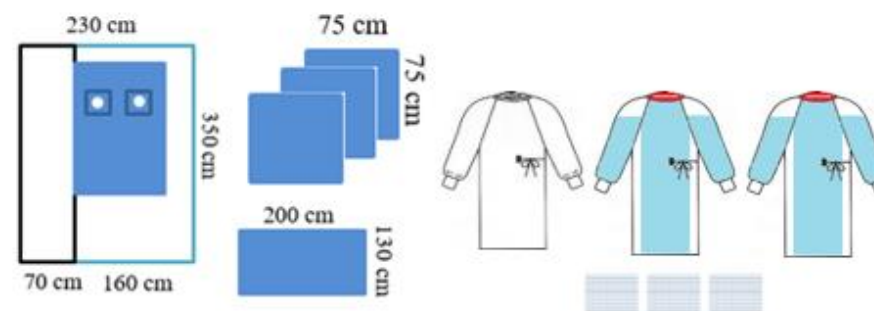


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222189	KIT HEMODINÂMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL VI C/ AVENTAL	06
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330046		

41. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 270 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 190 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 110 cm x 200 cm – Lateral

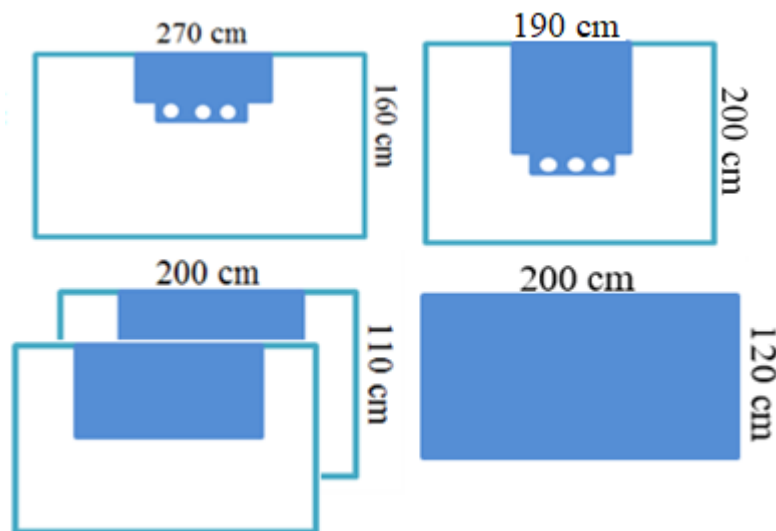

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222154	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

42. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I C/ 2 AVENTAIS

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 02 – Aventais Cirúrgicos Estéril G – Medida: 120 cm x 160 cm
- 02 – Toalhas Absorventes
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 270 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 190 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 110 cm x 200 cm – Lateral

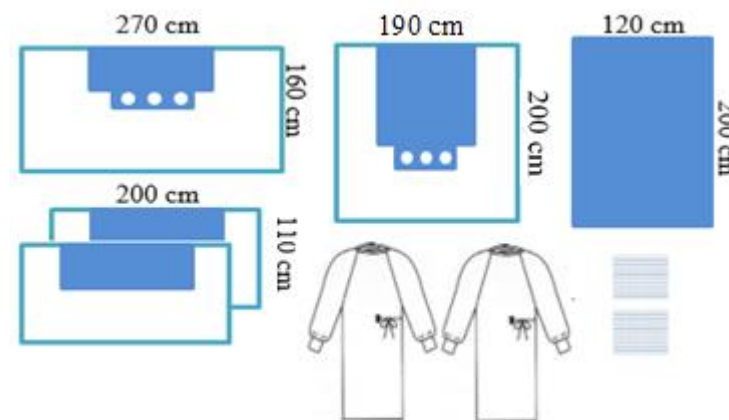

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222076	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I C/ 2 AVENTAIS	07


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330043
----------------------	--------------------	-----------------------------------

43. KIT CIR. UNIVERSAL ESTÉRIL I C/ MESA MAYO

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 40g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 270 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 190 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 110 cm x 200 cm – Lateral

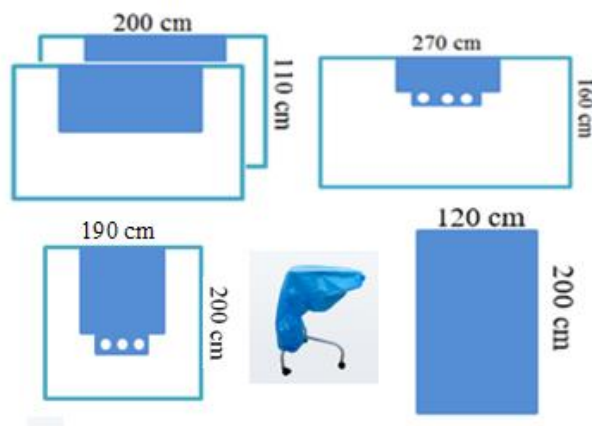

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222068	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I C/ MESA MAYO	08


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

44. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL III

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 40g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 240 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 180 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 90 cm x 100 cm – Lateral

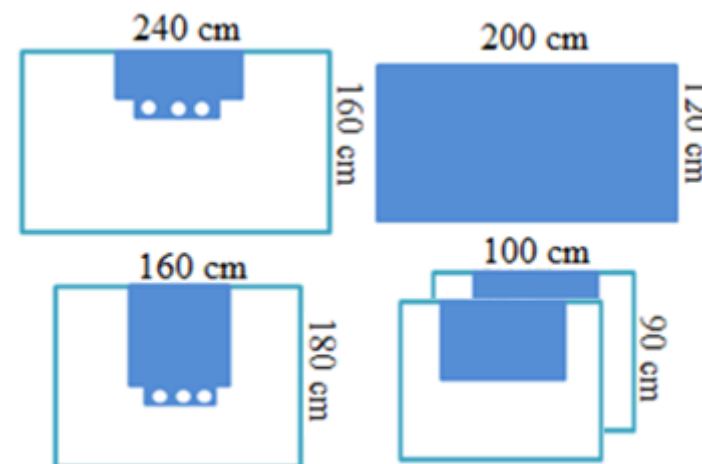

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222156	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL III	14


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

45. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL III INFANTIL

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 180 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 180 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 90 cm x 100 cm – Lateral

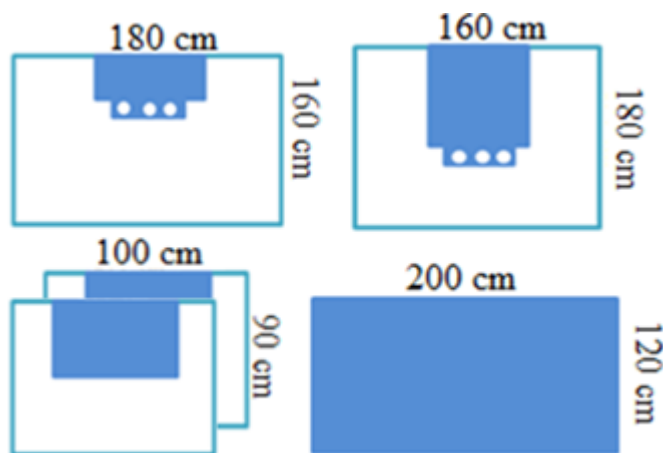

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222172	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL III INFANTIL	15


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

46. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL IV C/ AVENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Avental Cirúrgico Estéril XG – Medida: 135 cm x 175 cm
- 01 – Toalha Absorvente
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos:
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 150 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 150 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 160 cm x 100 cm – Lateral

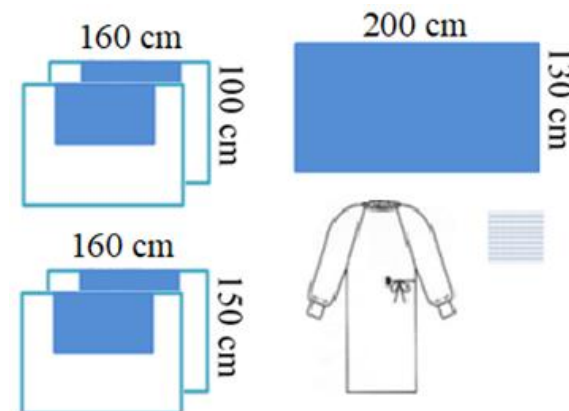

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222145	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL IV C/ AVENTAL (PQ. CIR.)	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330043
----------------------	--------------------	-----------------------------------

47. KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTÉRIL V C/ AVENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 02 – Aventais Cirúrgicos Estéril XG – Medida: 135 cm x 175 cm
- 02 – Toalhas Absorventes
- 01 – Campo Cirúrgico para Instrumental M – Medida: 30 cm x 35 cm (4 divisórias)
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 260 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 100 cm x 160 cm – Lateral

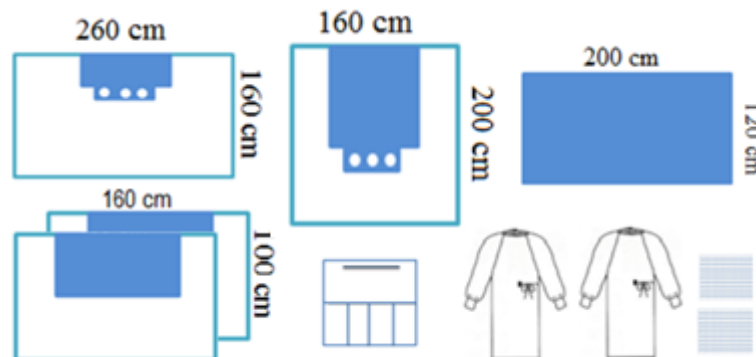

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222166	KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTÉRIL V C/ AVENTAL	06


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330043
----------------------	--------------------	-----------------------------------

48. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII S/ AVENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m² ou 40g/m², com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 260 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 100 cm x 160 cm – Lateral

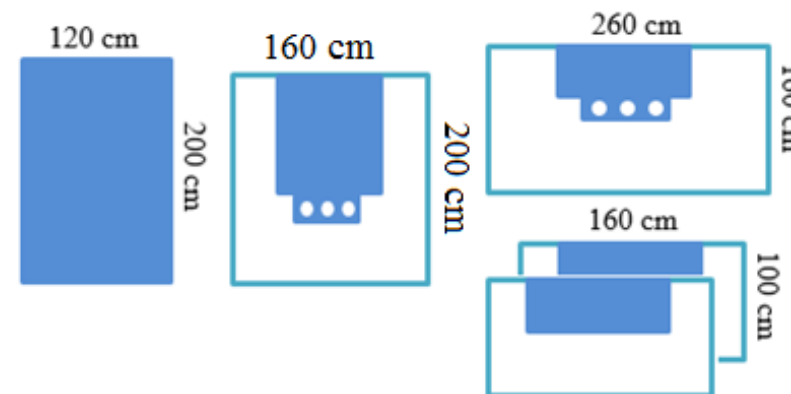

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222181	KIR CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII 50G S/ AVENTAL	10
222074	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII 40G S/ AVENTAL	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

**49. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII C/
AVENTAL**

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 02 Aventais Cirúrgicos Estéril G – 50G - Medida: 120 cm x 160 cm (222169) e 02 Aventais Cirúrgicos STD Estéril G – 40G – Medida: 120 cm x 160 cm (222073).
- 02 Toalhas Absorventes
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 50g/m² ou 40g/m², com reforço impermeável 55g/m² ou 48g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 260 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 100 cm x 160 cm – Lateral

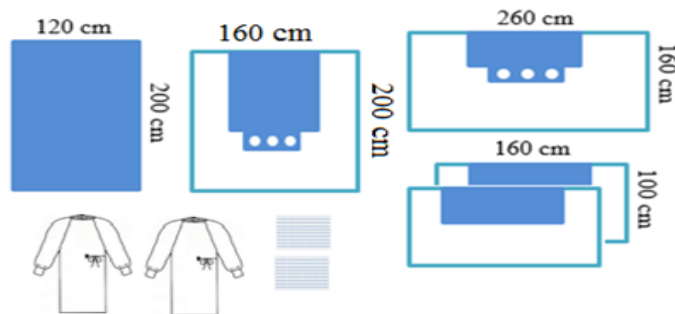

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222169	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII 50G C/ AVENTAL	08
222073	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII 40G C/ AVENTAL	08


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330043
------------------------------------	----------------------------------	---

50. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII
COM 2 AVENTAIS E MESA MAYO

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 02 Aventais Cirúrgicos Estéril G – Medida: 120 cm x 160 cm
- 02 Toalhas Absorventes
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 40g/m² com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 260 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 100 cm x 160 cm – Lateral

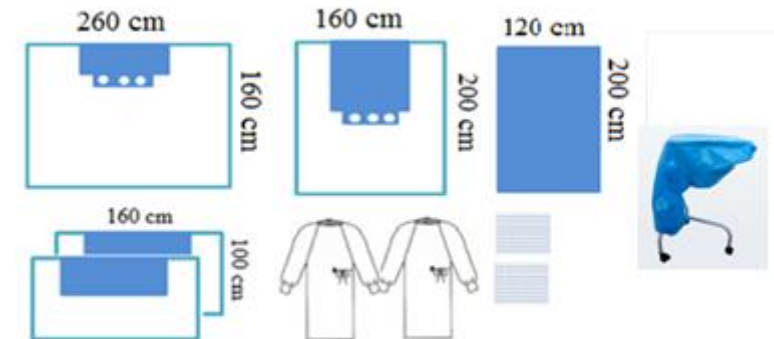

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222183	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII COM AVENTAIS E MESA MAYO	06


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330043
------------------------------------	----------------------------------	---

51. KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL VIII COM MESA MAYO E INSTRUMENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm
- 01 - Campo Cirúrgico para Instrumental M – Medida: 30 cm x 35 cm (4 divisórias)
- 04 Campos confeccionados em polipropileno – SMS 40g/m² com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
 - 01 Campo Cirúrgico 160 cm x 260 cm - Superior
 - 01 Campo Cirúrgico 200 cm x 160 cm - Inferior
 - 02 Campos Cirúrgicos 100 cm x 160 cm – Lateral

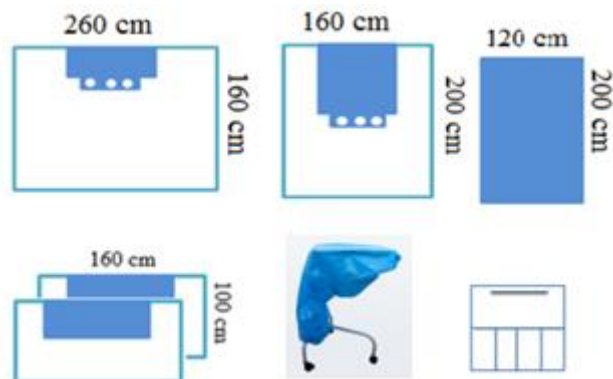

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222072	KIT CIR. UNIVERSAL ESTÉRIL VIII COM M. DE MAYO E INSTRUMENTAL	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

52. KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL VARIZES

Indicação de Uso:

Indicado para cirurgia de varizes. Destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 200 cm, fenestrado em “U” (medida de 30 cm x 50 cm), com fita adesiva hipoalergênica, alças para fixação de cabos a tubos e reforço laminado absorvente 55g/m².
- 01 - Campo Cirúrgico (Superior) confeccionado em polipropileno – SMS 50g/m² na medida de 160 cm x 180 cm, com fita adesiva hipoalergênica.
- 01 - Protetor de períneo em SMS 50g/m²
- 01 - Par de propés em SMS

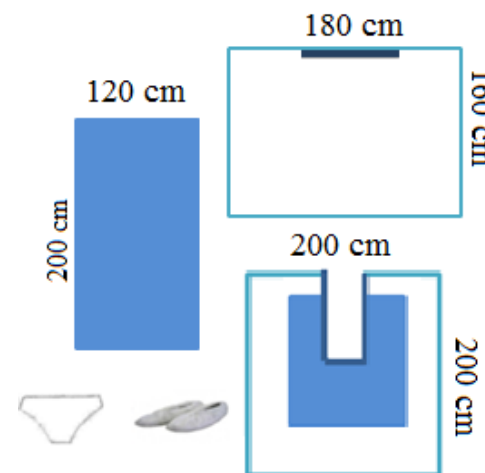

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222168	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL VARIZES	14


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330037
----------------------	--------------------	-----------------------------------

53. CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO DE PERNAS 80 CM x 130 CM

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos gineco/uro/procto onde há a necessidade do isolamento das pernas.

- 01 – Par de “Perneiras” para proteção de pernas em SMS 40g/m² na medida de 80 cm x 130 cm, com fita adesiva hipor alergênica (35 cm)
- Dobra asséptica.
- Dupla embalagem em invólucro em SMS 25g/m² na medida de 60 cm x 60 cm e Papel Grau Cirúrgico.

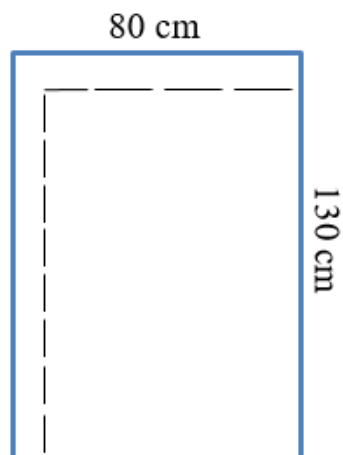

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/Cx
225150	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL P/ PROTEÇÃO DE PERNAS 80 CM X 130 CM	16


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330053
-----------------------------	---------------------------	--

54. CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM BOLSA COLETORA DE FLUIDOS

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde o paciente permaneça em posição ginecológica e exista a necessidade da coleta de grandes quantidades de líquidos e fluídos.

- Bolsa coletora de fluídos, aderida em campo plástico de polietileno com reforço impermeável 48g/m², com filtro e conexão para tubo de aspiração de secreções e partículas.
- Medida do campo: 103 cm x 115 cm.
- Dupla embalagem com invólucro em plástico na medida de 60 cm x 60 cm e Papel Grau Cirúrgico.

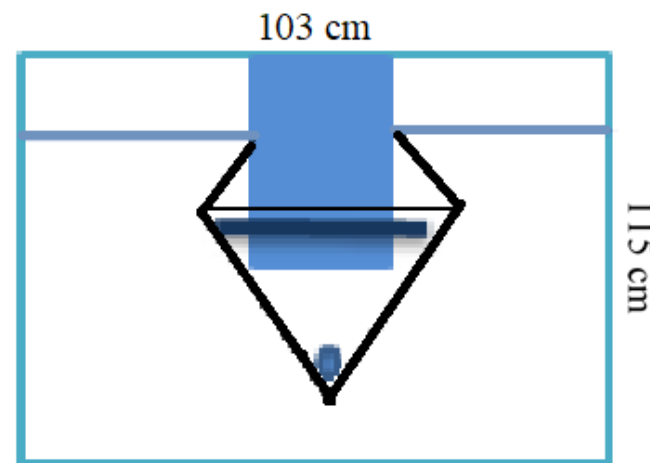

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
225156	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL C/ BOLSA COLETORA DE FLUIDOS	30


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330052
-----------------------------	---------------------------	--

55. KIT PARTO NORMAL/GINECO/URO ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos: ginecológicos, urológicos (RTU) e parto normal.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico em plástico de polietileno com bolsa coletora de fluidos com filtro na medida de 103 cm x 115 cm com conexão para tudo de aspiração.
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (superior) na medida de 160 cm x 200 cm com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
- 01 - Par de "Perneiras" para proteção das pernas em SMS 40g/m² na medida de 80 cm x 130 cm com fita adesiva hipoalergênica.

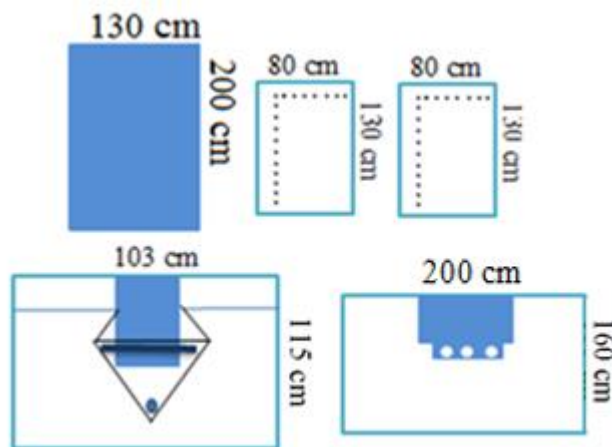


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222192	KIT CIR. PARTO NORMAL/GINECO/URO (BOLSA C/ FILTRO)	14
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330042		

56. KIT CIRÚRGICO /GINECO/URO C/ AVENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos: ginecológicos, urológicos (RTU) e parto normal.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Avental Cirúrgico Estéril XG - Medida: 135 cm x 175 cm
- 01 - Avental Cirúrgico Impermeável Estéril XG - Medida: 135 cm x 175 cm
- 02 - Toalhas Absorventes
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 40g/m² na medida de 60 cm x 40 cm com fita adesiva hipoalergênica
- 01 - Campo Cirúrgico em plástico de polietileno com bolsa coletora de fluidos (com filtro) na medida de 103 cm x 115 cm com conexão para tudo de aspiração.
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (superior) na medida de 160 cm x 200 cm com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
- 01 - Par de "Perneiras" para proteção das pernas em SMS 40g/m² na medida de 80 cm x 130 cm com fita adesiva hipoalergênica.

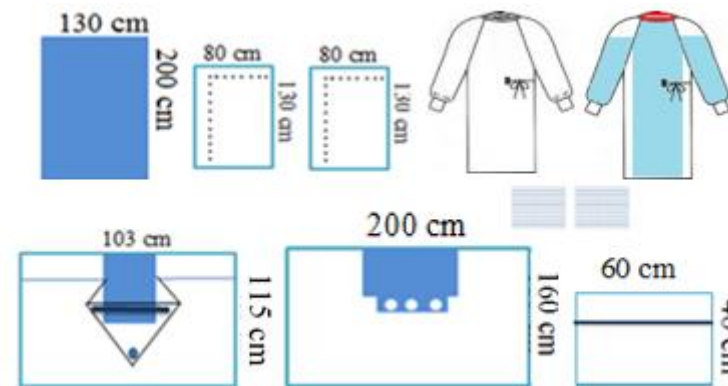


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222144	KIT CIRÚRGICO GINECO/URO C/ AVENTAL	08
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330045		

57. KIT CIRÚRGICO PARA CESÁREA

Indicação de uso:

Indicado para cesária com finalidade de coletar sangue e líquido amniótico através de bolsa coletora de fluidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico em "T" em SMS 50g/m² na medida de 250 cm x 180 cm x 300 cm com fenestra abdominal com filme adesivo hipoalergênico incisional de 30 cm x 30 cm, alças para fixação de cabos e tubos, bolsa coletora com 2 conexões para tubo de aspiração de secreções e fluídos corpóreos.

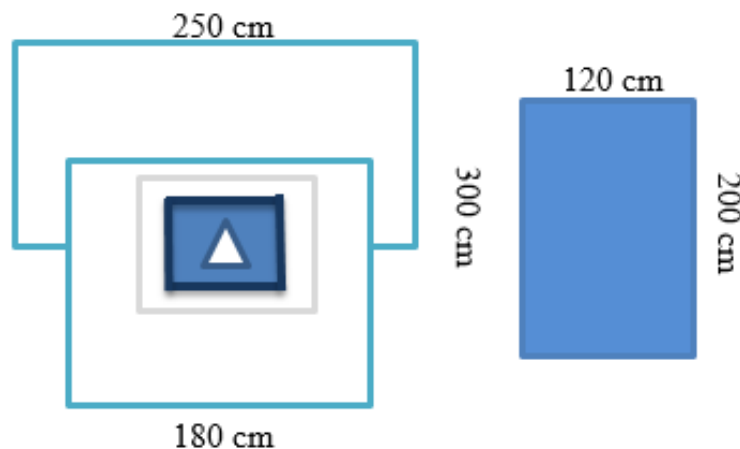


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222207	KIT CIRÚRGICO PARA CESÁREA	10
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330061		

58. KIT CIRÚRGICO PARA CESÁREA COM AVENTAL

Indicação de uso:

Indicado para cesária com finalidade de coletar sangue e líquido amniótico através de bolsa coletora de fluidos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico em "T" em SMS 50g/m² na medida de 250 cm x 180 cm x 300 cm com fenestra abdominal com filme adesivo hipoalergênico incisional de 30 cm x 30 cm, alças para fixação de cabos e tubos, bolsa coletora com 2 conexões para tubo de aspiração de secreções e fluídos corpóreos.
- 03 - Aventais Cirúrgicos STD Estéril G – Medida: 120 cm x 160 cm.
- 03 - Toalhas Absorventes.

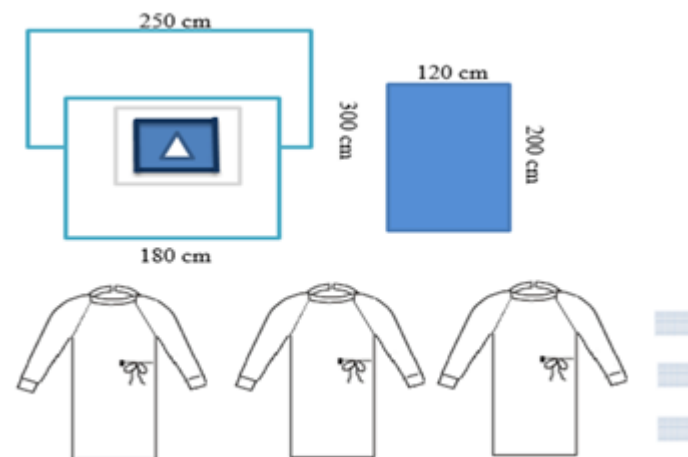


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222245	KIT CIRÚRGICO PARA CESÁREA COM AVENTAL	6
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330072		

59. KIT LITOTOMIA ESTÉRIL**Indicação de Uso:**

Indicado para procedimentos ginecológicos, hemorroidectomia, colpoperineoplastia e TVT – correção de incontinência urinária.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (superior) na medida de 160 cm x 100 cm com fitas adesivas hipoalergênicas.
- 01 - Campo Cirúrgico em Laminado (inferior) 48g/m² para isolamento da mesa cirúrgica do paciente na medida de 100 cm x 110 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 60 cm x 40 cm com fita adesiva hipoalergênica
- 02 - Campos Cirúrgicos para proteção de pernas em SMS 40g/m² na medida de 80 cm x 130 cm com fita adesiva hipoalergênica.
- 01 - Toalha Absorvente na medida 39 cm x 50 cm

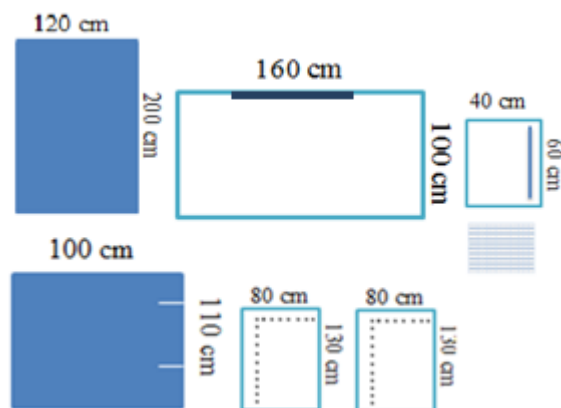


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222185	KIT LITOTOMIA ESTÉRIL	20

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330047
-----------------------------	---------------------------	--

60. KIT GINECO/URO I**Indicação de Uso:**

Indicado para procedimentos ginecológicos e urológicos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico em Laminado 48g/m² para isolamento da mesa cirúrgica do paciente na medida de 100 cm x 110 cm.
- 02 - Campos Cirúrgicos para proteção de pernas em SMS 40g/m² na medida de 80 cm x 130 cm com fita adesiva hipoalergênica.
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 280 cm x 90 cm x 260 cm com reforço impermeável 55g/m², com uma janela abdominal de 30 cm x 30 cm e uma janela perineal de 08 cm x 15 cm, ambas com fitas adesivas hipoalergênicas ao redor das janelas e alças para fixação de cabos e tubos.

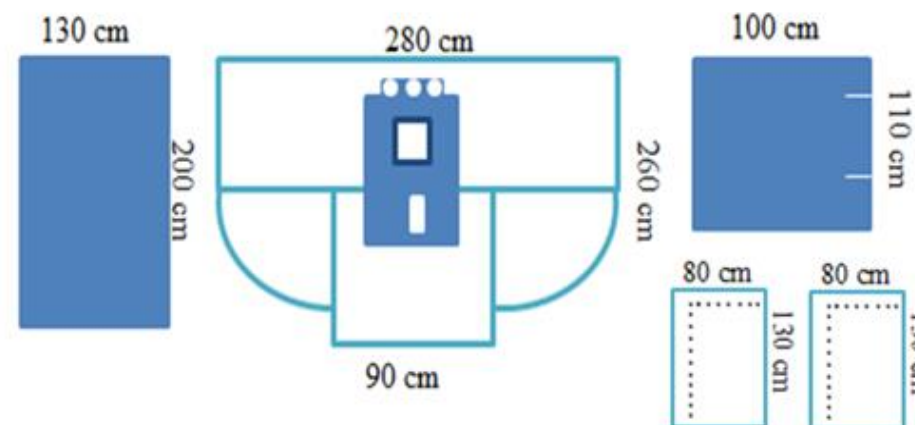

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222201	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GINECO/URO I	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330042
-----------------------------	---------------------------	--

61. KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GINECO/URO II COM ACESSO PERINEAL E BOLSA COLETORA

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos: ginecológicos, urológicos (RTU) que tenham quantidades expressivas de fluídos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico em Laminado 48g/m² para isolamento da mesa cirúrgica do paciente na medida de 100 cm x 110 cm.
- 02 – Campos Cirúrgicos para proteção de pernas em SMS 40g/m² na medida de 80 cm x 130 cm com fita adesiva hipoalergênica.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 275 cm x 90 cm x 260 cm com reforço impermeável 55g/m², com fenestra perineal de 08 cm x 15 cm, com fita adesiva hipoalergênica ao redor da fenestra, alças para fixação de cabos e tubos e bolsa coletora de fluídos com filtro para coleta de fragmentos e conexão para tubo de aspiração.

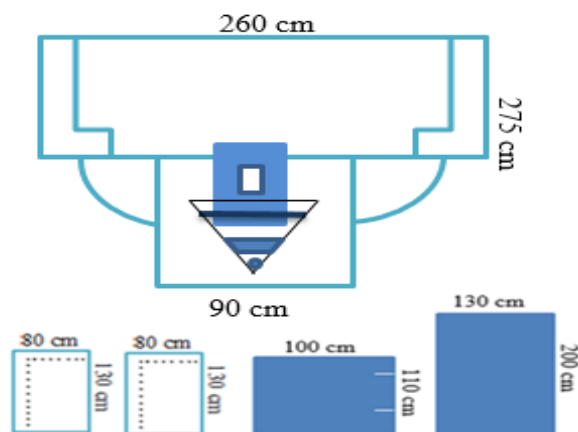

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222209	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GINECO/URO II	07


Esterilização ETO	Validade 3anos	Regi. ANVISA 80166330042
----------------------	-------------------	-----------------------------

62. KIT CIRÚRGICO LAPAROSCOPIA C/BOLSAS LATERAIS

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos de Laparoscopia.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 140 cm
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² para Laparoscopia em “T” na medida de 300 cm x 200 cm x 350 cm com reforço impermeável 55g/m², com uma fenestra abdominal na medida de 30 cm x 30 cm com fita adesiva hipoalergênica, alças para fixação de cabos e tubos e bolsas laterais coletoras de fluídos.

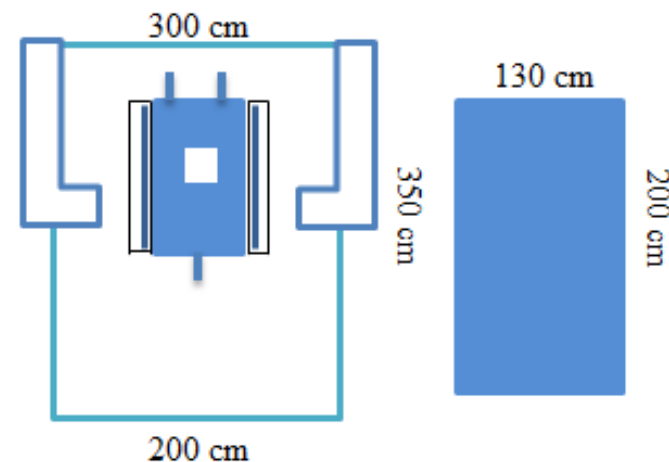

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222087	KIT CIRÚRGICO LAPAROSCOPIA C/ BOLSAS LATERAIS	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330052
----------------------	--------------------	-----------------------------------

63. KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GERAL “U/BAR”

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos: abdominais, plásticos, ortopédicos, neurológicos, etc.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (superior) na medida de 160 cm x 260 cm com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 300 cm fenestrado em “U” (10 cm x 50 cm), com reforço impermeável 55g/m², e fita adesiva hipoalergênica na borda da fenestra e alças para fixação de cabos e tubos.

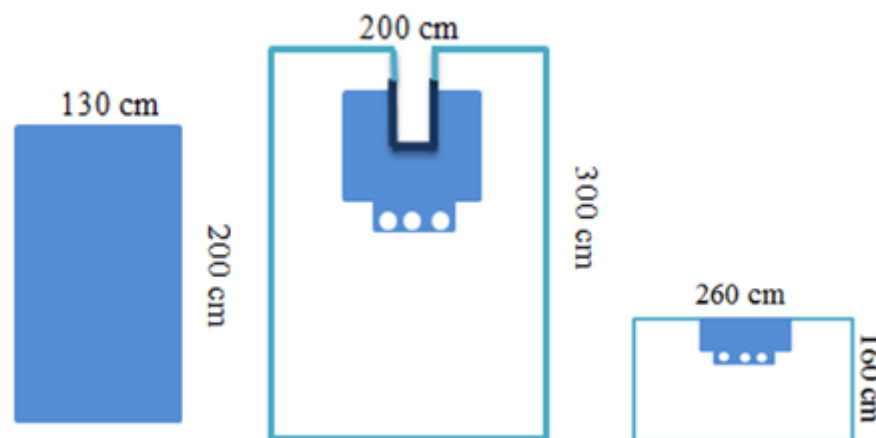

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222135	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GERAL “U/BAR”	14


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330041
----------------------	--------------------	-----------------------------------

64. KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GERAL “U/BAR” II COM 2 AVENTAIS E MESA MAYO.

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos: abdominais, plásticos, ortopédicos, neurológicas, etc.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 02 – Aventais Cirúrgicos Estéril G – Medida: 120 cm x 160 cm
- 02 – Toalhas Absorventes
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (superior) na medida de 160 cm x 260 cm com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 300 cm fenestrado em “U” (10 cm x 50 cm), com reforço impermeável 55g/m², e fita adesiva hipoalergênica na borda da fenestra e alças para fixação de cabos e tubos.

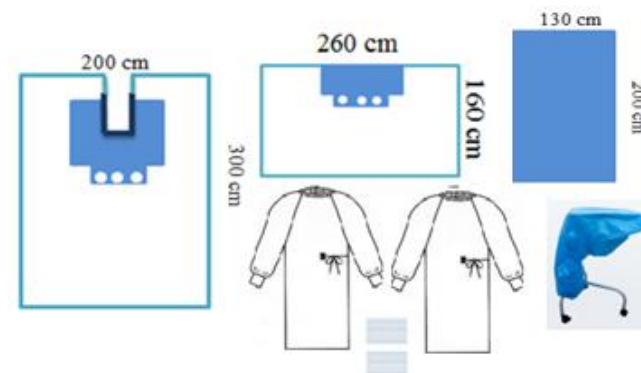


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222136	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GERAL “U/BAR” II	08

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330041
----------------------	--------------------	-----------------------------------

65. KIT CARDÍACO ESTÉRIL**Indicação de Uso:**

Indicado para procedimentos cirúrgicos cardíacos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm;
- 01 – Campo Cirúrgico para Instrumental M – Medida: 30 cm x 35 cm (4 divisórias)
- 01 – Campo Cirúrgico P/ Pás do Desfibrilador - Medida: 62 cm x 30 cm (2 divis.)
- 02 – Campos Cirúrgicos em SMS 50g/m² na medida de 40 cm x 40 cm com fenestra circular de 10 cm de diâmetro.
- 04 – Campos Cirúrgicos em SMS 40g/m² na medida de 40 cm x 70 cm, com fita adesiva hipoalergênica.
- 02 – Campos Cíurgicos Simples em SMS 50g/m² na medida de 160 cm x 200 cm
- 01 – Campo Cirúrgico Aproximação com protetor de perineo em Laminado 48g/m² na medida de 200 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico Cardíaco em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 350 cm. fenestrado em “U” com reforço impermeável 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica em volta da fenestra.
- 01 – Par de Pro-pés em SMS 40g/m²

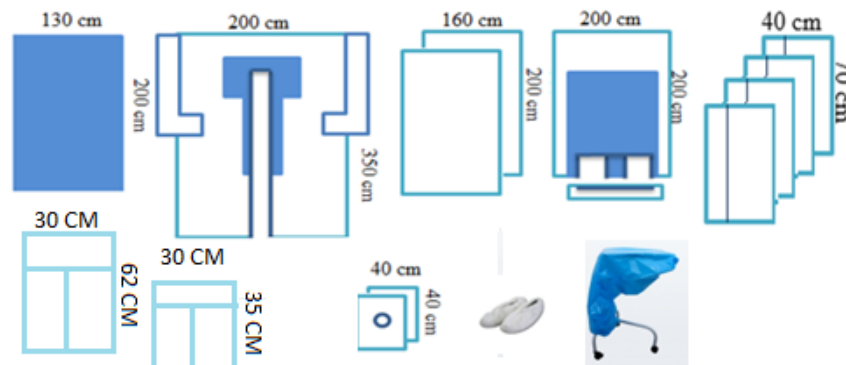


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222187	KIT CARDÍACO ESTÉRIL	06

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330064
----------------------	--------------------	-----------------------------------

66. KIT CARDÍACO ESTÉRIL 40G**Indicação de Uso:**

Indicado para procedimentos cirúrgicos cardíacos.

- 03 - Campos Impermeáveis de Mesa confeccionados em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 140 cm;
- 01 – Campo Cirúrgico para Instrumental M – Medida: 30 cm x 35 cm (4 divisórias)
- 01 – Campo Cirúrgico P/ Pás do Desfibrilador - Medida: 62 cm x 30 cm (2 divis.)
- 02 – Campos Cirúrgicos em SMS 40g/m² na medida de 40 cm x 70 cm, com fita adesiva hipoalergênica.
- 01 – Campo Cíurgico Simples em SMS 40g/m² na medida de 160 cm x 200 cm
- 01 – Campo Cirúrgico Aproximação com protetor de perineo em Laminado 48g/m² na medida de 200 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico Cardíaco em SMS 40g/m² na medida de 200 cm x 350 cm. fenestrado em “U” com reforço impermeável 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica em volta da fenestra.
- 01 – Campo Cirúrgico Impermeável confeccionado em laminado plástico 48g/m² na medida de 180 cm x 200 cm para mesa auxiliar – varal.
- 01 – Par de Pro-pés em SMS 40g/m².

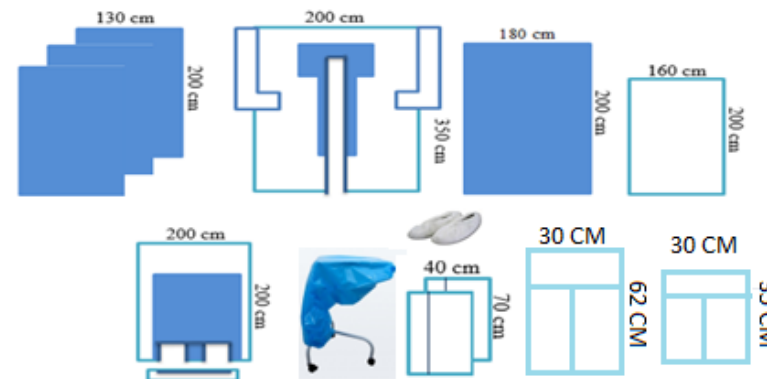

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222241	KIT CARDÍACO ESTÉRIL 40G	06


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330064
----------------------	--------------------	-----------------------------------

67. KIT CIRÚRGICO CARDÍACO COM BOLSA

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos cardíacos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 140 cm
- 02 – Campos Cirúrgicos em SMS 40g/m² na medida de 40 cm x 70 cm, com fita adesiva hipoalergênica.
- 01 – Campo Cirúrgico Aproximação com protetor de perineo em Laminado 48g/m² na medida de 200 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico Cardíaco em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 350 cm. fenestrado em “U” com reforço impermeável 55g/m², fita adesiva hipoalergênica em volta de toda a fenestra e bolsa coletora de fluídos.
- 01 – Par de Pro-pés em SMS 40g/m²

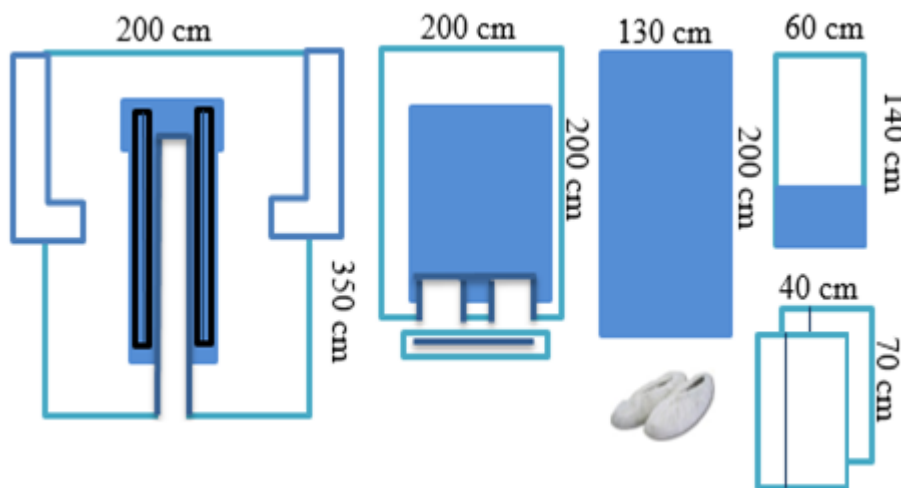


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222236	KIT CARDÍACO COM BOLSA COLETORA ESTÉRIL	08
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330065		

68. CONJUNTO UNIVERSAL PARA CARDIO II

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos cardíacos.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 140 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (superior) na medida de 160 cm x 270 cm com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² (inferior) na medida de 200 cm x 190 cm com reforço impermeável 55g/m², fitas adesivas hipoalergênicas, e alças para fixação de cabos e tubos.
- 02 – Campos Cirúrgicos em SMS 50g/m² (laterais) na medida de 110 cm x 200 cm com reforço impermeável 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica.
- 01 – Campo Cirúrgico Aproximação com protetor de perineo em Laminado 48g/m² na medida de 200 cm x 200 cm com duas fenestras em “U” (50 cm x 16 cm) .
- 01 – Campo Cirúrgico para Quadril em Laminado 48g/m² na medida de 150 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Instrumental M – Medida: 30 cm x 35 cm (4 divisórias)
- 01 – Campo Cirúrgico P/ Pás do Desfibrilador - Medida: 62 cm x 30 cm (2 divisórias)
- 01 – Campo Cirúrgico impermeável confeccionado em laminado branco mais laminado azul, unidos por Hot Melt, ambos na medida de 75 cm x 75 cm com fenestra central de 16 cm de diâmetro.
- 06 – Campos Cirúrgicos em SMS 40g/m² na medida de 70 cm x 40 cm com fita adesiva hipoalergênica.
- 02 – Campos Cirúrgicos Avulsos em SMS 50g/m² na medida de 160 cm x 200 cm para fixação extra.
- 01 – Par de Pro-pés em SMS 40g/m²

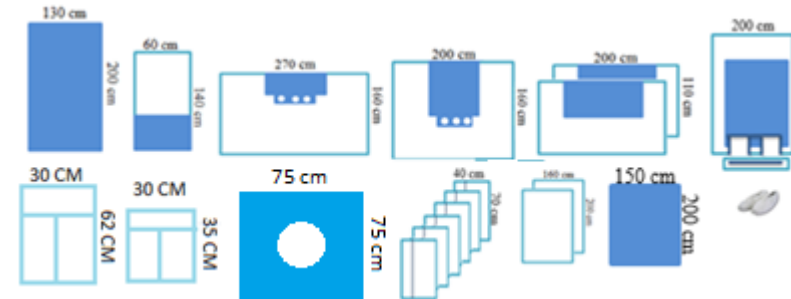


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222195	CONJUNTO UNIVERSAL PARA CARDIO II	05
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330063		

69. CAMPO CIRÚRGICO PARA APROXIMAÇÃO 150 CM X 200 CM ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos em ortopedia onde seja necessária a manutenção da técnica asséptica e impermeabilidade á líquidos e fluídos.

- 01 – Campo Cirúrgico para aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestras em “U” de 10 cm x 50 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- Dobra asséptica.
- Dupla embalagem com Invólucro confeccionado em plástico liso, na medida de 50 cm x 50 cm e Papel Grau Cirúrgico.

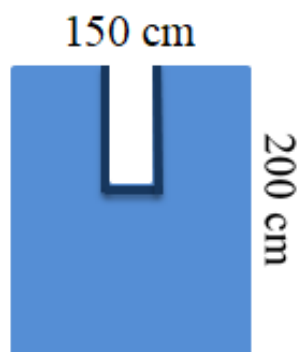

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
225157	CAMPO CIR. ESTÉRIL ORT P/ APROXIMAÇÃO 150 CM X 200 CM	50


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330050
----------------------	--------------------	-----------------------------------

70. BOTA CIRÚRGICA IMPERMEÁVEL ESTÉRIL 30 CM X 120 CM (stockinette)

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos onde seja necessário o isolamento de membros inferiores – joelho/fêmur.

- Bota cirúrgica impermeável em lâmina de polietileno c/ EVA, medindo 30 cm x 120 cm.
- Interior forrado em tecido de malha tubular.
- 02 Fitas adesivas impermeáveis e hipoalergênicas 10 cm x 50 cm.

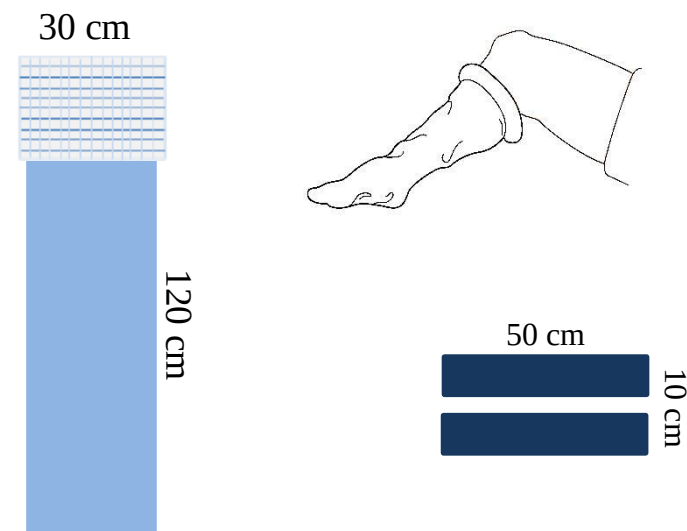

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
225158	BOTA CIRÚRGICA IMPERMEÁVEL 30 CM X 120 CM	32


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
----------------------	--------------------	------------------------------

71. KIT ORTOPEDIA EXTREMIDADE (MÃO/PÉ)

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de ortopedia.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em "U" de 10 cm x 50 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 - Campo Cirúrgico confeccionado em SMS 50g/m² medindo 200 cm x 300 cm, com reforço impermeável 55g/m² e fenestra elástica de 04 cm de diâmetro.

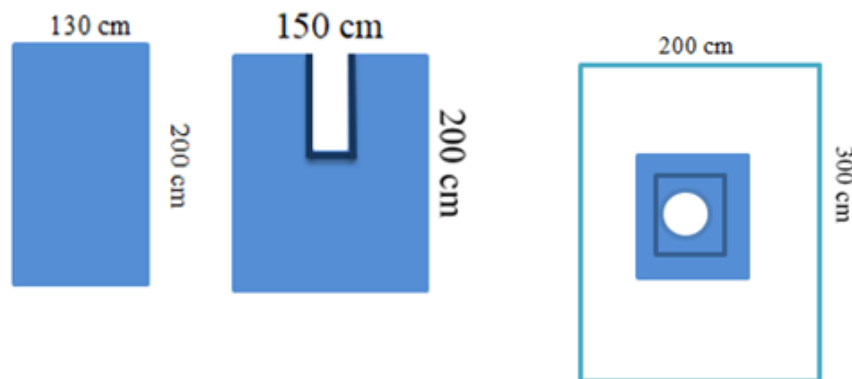

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222203	KIT ORTOPEDIA EXTREMIDADE (MÃO/PÉ)	04

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------


72. KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL MÃO II

Obs: Com indicação de sentido para mão direita ou esquerda.

Indicação de Uso:

Indicado para procedimento ortopédico em membro superior.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em "U" de 10 cm x 50 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 - Campo Cirúrgico confeccionado em SMS 50g/m² para Mão/Braço na medida de 360 cm x 200 cm x 160 cm, com reforço impermeável 55g/m², fenestra elástica de 04 cm de diâmetro, e alça para fixação de cabos e tubos.

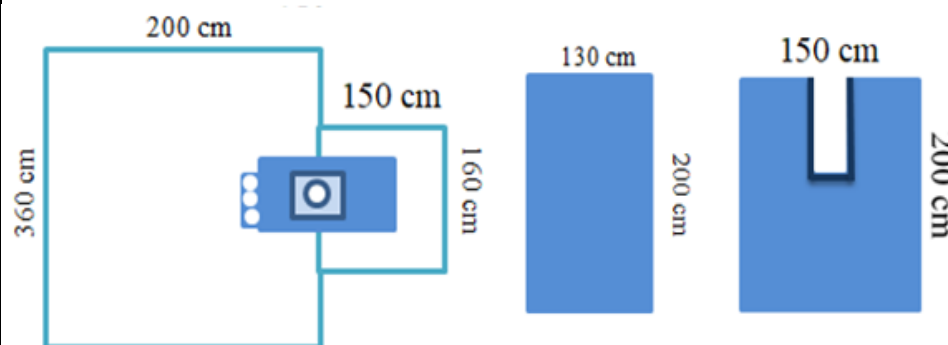

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222204	KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL MÃO II	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

73. KIT ARTROSCOPIA/JOELHO "U"

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de ortopedia.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm;
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em "U" de 70 cm x 16 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 – Campo Cirúrgico (Superior) em SMS 40g/m² na medida de 220 cm x 160 cm com reforço impermeável 55g/m², fita adesiva hipoalergênica e alças para fixação de cabos e tubos.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 40g/m² na medida de 220 cm x 200 cm com fenestra em "U" de 10 cm x 100 cm, reforço impermeável 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica ao redor da fenestra.
- 01- Bota cirúrgica impermeável em lâmina de polietileno c/ EVA, medindo 30 cm x 120 cm.
- 02 – Fitas adesivas hipoalergênicas – Medida: 10 cm x 50 cm. Brancas.

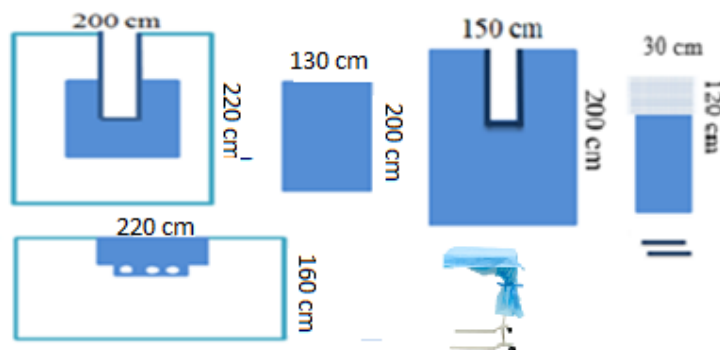

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222202	KIT ARTROSCOPIA/JOELHO "U"	08


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

74. KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL JOELHO

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de ortopedia (extremidade inferior).

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 120 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em "U" de 70 cm x 16 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m², medindo 280 cm x 330 cm, com reforço impermeável 55g/m², fenestra elástica de 06 cm fita adesiva hipoalergênica e alça para fixação de cabos e tubos.
- 01- Bota cirúrgica impermeável em lâmina de polietileno c/ EVA, medindo 30 cm x 120 cm.
- 03 – Fitas adesivas hipoalergênicas – Medida: 10 cm x 50 cm - Brancas.

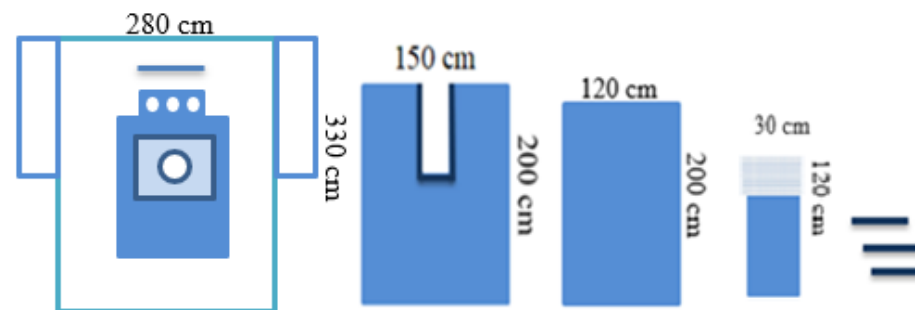

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222205	KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL JOELHO	08


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

75. KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL JOELHO (BILATERAL)

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos ortopédicos bilaterais.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em "U" de 10 cm x 50 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 - Campo Cirúrgico confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 300 cm x 200 cm com reforço impermeável 55g/m², 02 fenestras elásticas de 04 cm de diâmetro cada, e alça para fixação de cabos e tubos.

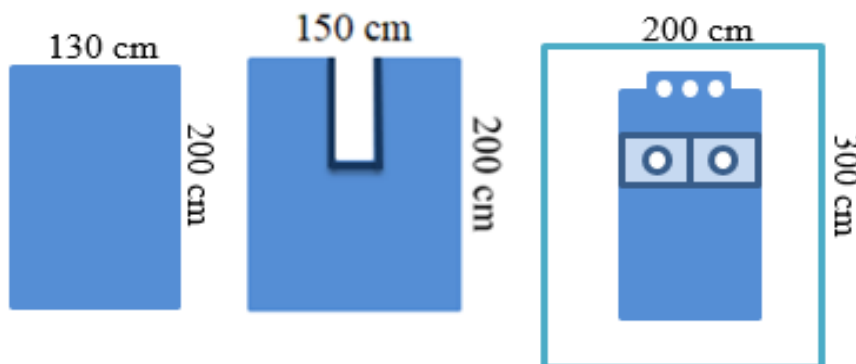

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222238	KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL JOELHO (BILATERAL)	10


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

76. KIT CIRÚRGICO ARTROSCOPIA ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de artroscopia

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em "U" de 70 cm x 16 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 - Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 310 cm, reforço impermeável 55g/m², fenestra elástica de 08 cm, alça para fixação de cabos e tubos e bolsa coletora de fluidos.
- 01 - Bota cirúrgica impermeável em lâmina de polietileno c/ EVA, medindo 30 cm x 120 cm.
- 03 - Fitas adesivas hipoalergênicas - Medida: 10 cm x 50 cm - Brancas

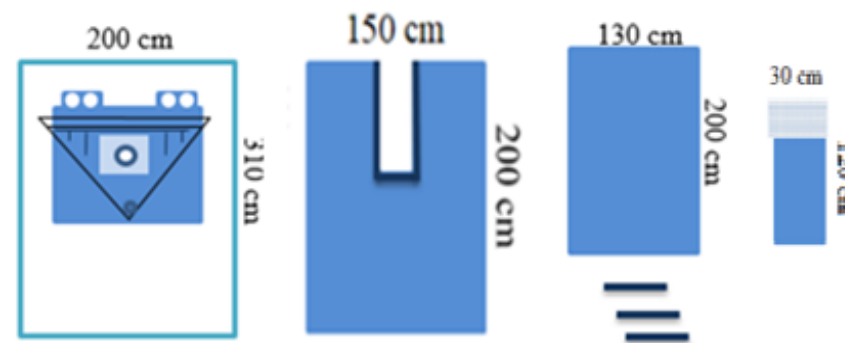

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222221	KIT CIRÚRGICO ARTROSCOPIA ESTÉRIL	07


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

77. KIT ORTOPEDIA CIRÚRGIA DE QUADRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de ortopedia.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Aventais Cirúrgicos Estéril G – Medida: 120 cm x 160 cm
- 02 – Aventais Cirúrgicos Estéril XG - Medida: 135 cm x 175 cm
- 03 – Toalhas Absorventes
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm;
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em “U” de 70 cm x 16 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 – Campo Cirúrgico para Quadril em “T”, em SMS 50g/m², na medida de 320 cm x 300 cm x 200 cm com reforço impermeável 55g/m², fenestra elástica de 16 cm de diâmetro e alça para fixação de cabos e tubos.
- 01 Campo SMS Simples em SMS 50g/m² na medida de 110 cm x 160 cm.
- 01- Bota cirúrgica impermeável em lâmina de polietileno c/ EVA, medindo 30 cm x 120 cm.
- 03 – Fitas adesivas hipoalergênicas – Medida: 10 cm x 50 cm – Brancas.

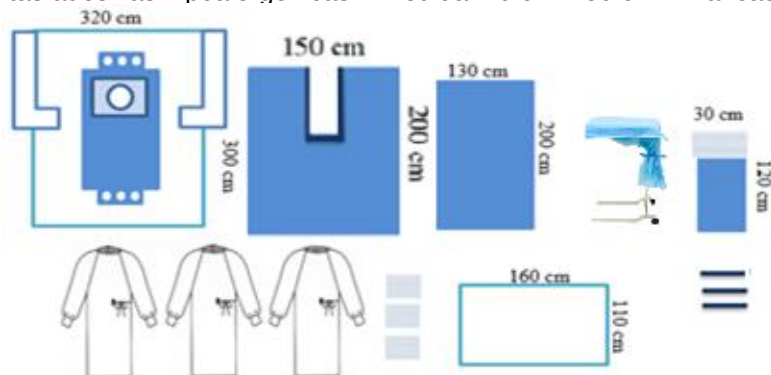

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222206	KIT ORTOPEDIA ESTÉRIL QUADRIL	05


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
-----------------------------	---------------------------	--

78. KIT CIRÚRGICO ORTOPEDIA ESTÉRIL QUADRIL S/ AVENTAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de ortopedias específicos para quadril.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico para Mesa de Mayo 60 cm x 135 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em “U” de 70 cm x 16 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 – Campo Cirúrgico para Quadril em “T”, em SMS 50g/m², na medida de 320 cm x 300 cm x 200 cm com reforço impermeável 55g/m², fenestra elástica de 16 cm de diâmetro e alça para fixação de cabos e tubos.
- 01- Campo SMS Simples em SMS 50g/m² na medida de 110 cm x 160 cm.
- 01- Bota cirúrgica impermeável em lâmina de polietileno c/ EVA, medindo 30 cm x 120 cm.
- 03 – Fitas adesivas hipoalergênicas – Medida: 10 cm x 50 cm – Brancas.

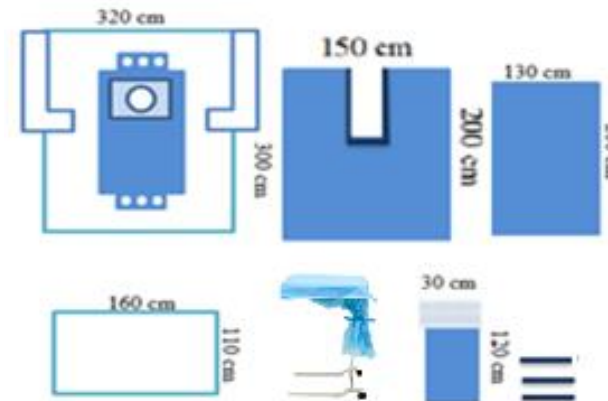

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222210	KIT CIRÚRGICO ORTOPEDIA ESTÉRIL QUADRIL S/ AVENTAL	07


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
-----------------------------	---------------------------	--

79. KIT ARTROSCOPIA QUADRIL COM BOLSA

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de artroscopia específicos para quadril.

- 01 – Campo Impermeável de Mesa confeccionado em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 Campo Cirúrgico para Quadril confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 330 cm x 200 cm com reforço impermeável confeccionado em laminado 55g/m², fenestra ovalada na medida de 19 cm x 30 cm com adesivo hipoalergênico incisional e bolsa coletora de fluidos.

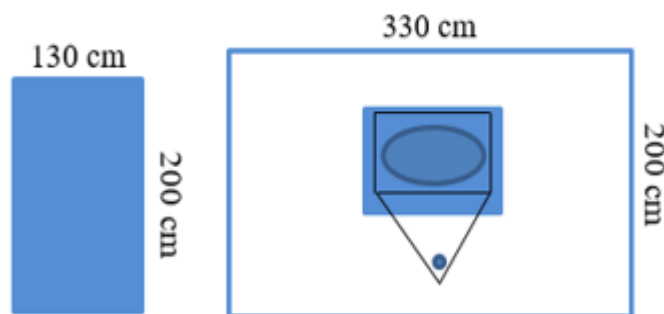

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222239	KIT CIRÚRGICO ARTROSCOPIA QUADRIL COM BOLSA	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

80. KIT CIRÚRGICO ORTOPEDIA ESTÉRIL OMBRO (cadeira de praia)

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de ortopedia específicos para ombro.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 430 cm x 250 cm, com reforço impermeável 55g/m² e fenestra pentagonal com fita adesiva hipoalergênica e alça para fixação de cabos e tubos.
- 01 – Bolsa coletora de fluídos avulsa para fixação no campo principal, na medida de 100 cm x 80 cm com fita adesiva.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em “U” de 10 cm x 50 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.

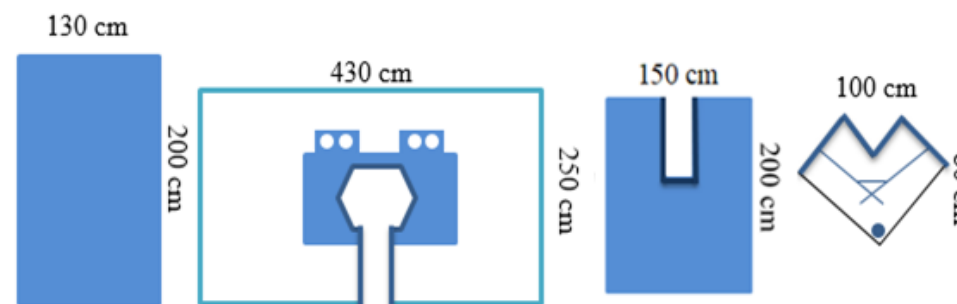

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222213	KIT CIRÚRGICO ORTOPEDIA ESTÉRIL OMBRO	08


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330044
----------------------	--------------------	-----------------------------------

81. CAMPO CIRÚRGICO ARTROSCOPIA OMBRO COM BOLSA ESTÉRIL (cadeira de praia)

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de artroscopia para ombro.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico para Aproximação confeccionado em laminado 55g/m², medindo 150 cm x 200 cm, com fenestra em “U” de 10 cm x 50 cm e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra.
- 01 - Campo Cirúrgico confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 400 cm x 260 cm com fenestra elástica de 08 cm de diâmetro, reforço impermeável 55g/m², fita adesiva hiporalgênica, 3 alças para fixação de cabos e tubos e bolsa coletora de fluídos com conector para tubo de aspiração.

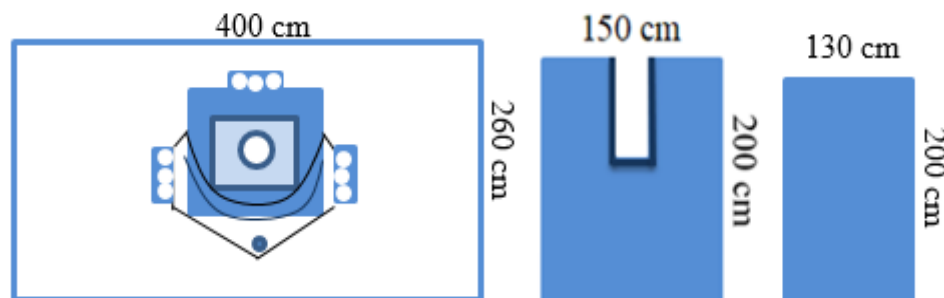

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222234	CAMPO CIRÚRGICO ARTROSCOPIA OMBRO C/ BOLSA ESTÉRIL	08


Esterilização
ETO
 Validade
3 anos
 Notificação ANVISA
80166330052

82. KIT CIRÚRGICO CABEÇA E PESCOÇO II

Indicação de Uso:

Indicado para diversos procedimentos cirúrgicos.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 200 cm x 300 cm, com fenestra em “U” de 08 cm x 65 cm e reforço impermeável 55g/m², fita adesiva hipoalergênica ao redor da fenestra e alça para fixação de cabos e tubos.
- 01 – Campo turbante em SMS 50g/m² para proteção de cabeça, na medida de 100 cm x 100 cm.

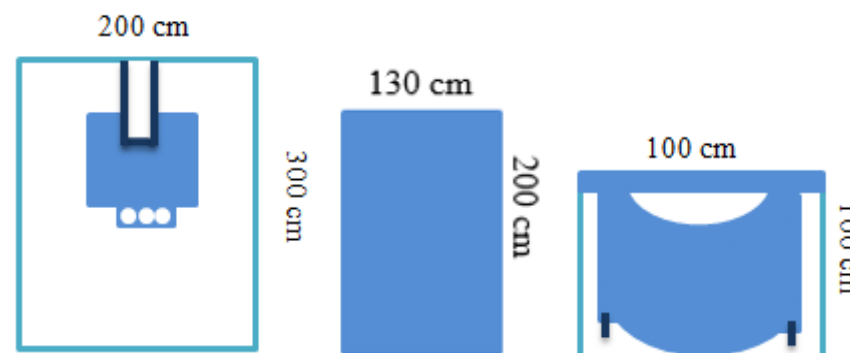

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222218	KIT CIRÚRGICO CABEÇA E PESCOÇO II	14


Esterilização
ETO
 Validade
3 anos
 Notificação ANVISA
80166330041

83. KIT CIRÚRGICO CRANIOTOMIA ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de craniotomia.

- 01 – Campo Cirúrgico Para Mesa auxiliar em laminado plástico 55g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 330 cm x 200 cm com fenestra de 19 cm de diâmetro, reforço impermeável 55g/m², fita adesiva hipoalergênica, alça para fixação de cabos e tubos e bolsa coletora de fluídos.
- 04 – Campos Cirúrgicos em SMS 40g/m² na medida de 40 cm x 70 cm, com fita adesiva hipoalergênica.

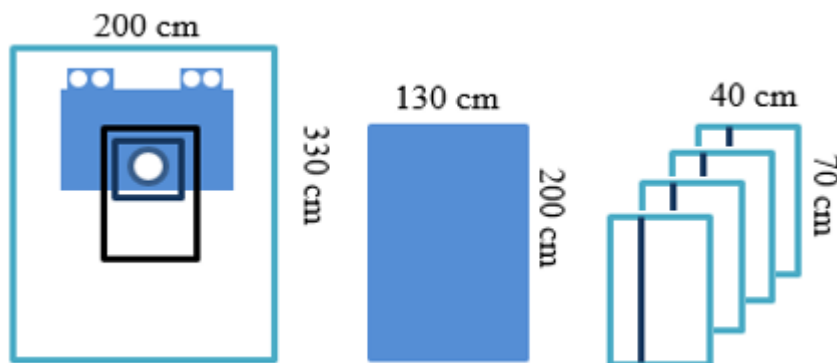


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
222220	KIT CIRÚRGICO CRANIOTOMIA ESTÉRIL	12			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização ETO</td> <td>Validade 3 anos</td> <td>Notificação ANVISA 80166330074</td> </tr> </table>			Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330074
Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330074			

84. CAMPO CIRÚRGICO PARA OTORRINO FENESTRADO 120 CM X 160 CM

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de otorrinolaringologia.

- Campo Cirúrgico para otorrino confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 120 cm x 160 cm, com fenestra de 10 cm de diâmetro feita a uma distância de 50 cm do centro da fenestra à extremidade superior do campo e fita adesiva hipoalergênica. Embalagem simples em papel grau cirúrgico.

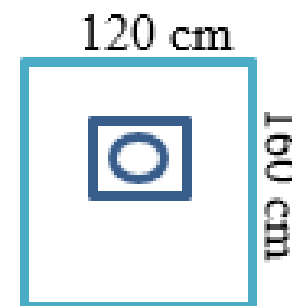

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
225131	CAMPO CIR. PARA OTORRINO FENEST. 10 CM 120 CM X 160 CM – 50g/m ²	16			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização ETO</td> <td>Validade 3 anos</td> <td>Notificação ANVISA 80166330051</td> </tr> </table>			Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051
Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051			

85. CAMPO CIRÚRGICO PARA OTORRINO FENESTRADO


Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de otorrinolaringologia.

Para o código: 225131: Campo Cirúrgico para otorrino confeccionado em SMS 50g/m² na medida de 120 cm x 160 cm, com fenestra de 10 cm de diâmetro feita a uma distância de 50 cm do centro da fenestra à extremidade superior do campo e fita adesiva hipoalergênica. Embalagem simples em papel grau cirúrgico.

Para o código: 225224:

- 01 Campo Cirúrgico Para Mesa auxiliar confeccionado em NT laminado Impermeável 48g/m² - Medida: 130 cm x 200 cm;
 - 01 Campo Cirúrgico para otorrinolaringologia, confeccionado em SMS 40g/m² na medida de 160 cm x 250 cm com fenestra de 10 cm de diâmetro feita a uma distância de 50 cm do centro da fenestra à extremidade superior do campo, com área de reforço impermeável 55g/m², e fita adesiva hipoalergênica em volta da fenestra;
- 01 Campo Cir. SMS Simples, confeccionado em SMS 40 g/m², medida 100 cm x 100 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225131	CAMPO CIR. PARA OTORRINO FENEST. 10 CM 120 CM X 160 CM – 50g/m ²	16
225224	CAMPO CIR. PARA OTORRINO FENEST. 10 CM 160 CM X 250 CM - 40g/m ²	30


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051
-----------------------------	---------------------------	--

86. CAMPO CIRÚRGICO PARA OTORRINO FENESTRADO 16 CM ESTÉRIL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de otorrino.

- 01 Campo Impermeável de Mesa confeccionado em laminado plástico 48g/m² na medida de 130 cm x 200 cm.
- 01 Campo para Otorrino confeccionado em SMS 40g/m² com fenestra de 16 cm diâmetro, reforço impermeável confeccionado em laminado plástico 48g/m², fita adesiva hipoalergênica ao redor de toda a fenestra e alça para fixação de cabos e tubos.

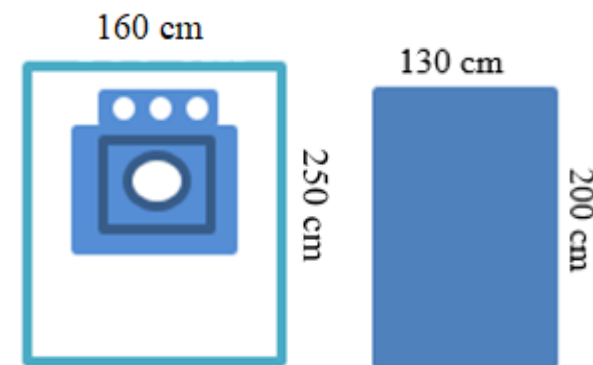

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225255	CAMPO CIR. PARA OTORRINO FENEST. 16 C/ REFORÇO E ADESIVO ESTÉRIL	20


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330051
-----------------------------	---------------------------	--

87. CAMPO CIRÚRGICO OFTALMO EM SMS ESTÉRIL COM BOLSA COLETORA

Indicação de Uso:

Indicado para os procedimentos cirúrgicos oftalmológicos que exista a necessidade da coleta de líquidos e fluidos.

- Campo confeccionado em SMS 40g/m², com fenestra circular de 08 cm de diâmetro, adesivo hipor alergênico e bolsa coletora de fluidos na medida de 20 cm x 25 cm.
- Campos com várias opções de medidas.

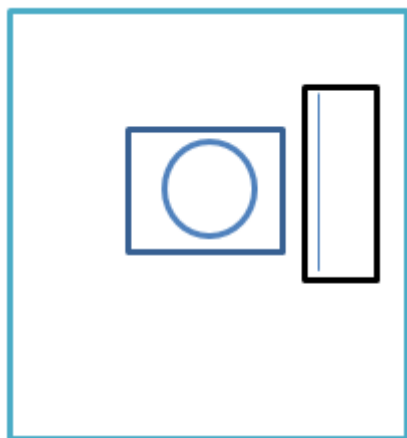

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/ CX
225119	CAMPO CIRÚRGICO SMS PARA OFTALMO COM BOLSA 75CMX75CM	100
225176	CAMPO CIRÚRGICO SMS PARA OFTALMO COM BOLSA 100CMX120CM	40
225191	CAMPO CIRÚRGICO SMS PARA OFTALMO COM BOLSA 140CMX100CM	25
225132	CAMPO CIRÚRGICO. SMS PARA OFTALMO COM BOLSA 120CMX160CM	30

Esterilização
ETO

Validade
3 anos


Notificação ANVISA
80166330052

88. KIT CATARATA STANDART

Indicação de Uso:

Indicado para os procedimentos cirúrgicos oftalmológicos que exista a necessidade da coleta de líquidos e fluidos.

- 01 Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 100 cm x 140 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico oftálmico em SMS 40g/m² na medida de 100 cm x 120 cm, com fenestra de 08 cm, adesivo e bolsa coletora de fluidos.
- 02 – Aventais Cirúrgicos Tamanho G – Medida: 120 cm x 160 cm.
- 02 – Toalhas Absorventes
- 20 – Compressas de Gaze 13 fios na medida de 7,5 cm x 7,5 cm.
- 05 – Hastes flexíveis de Algodão
- 01 – Oclutor ocular acrílico.

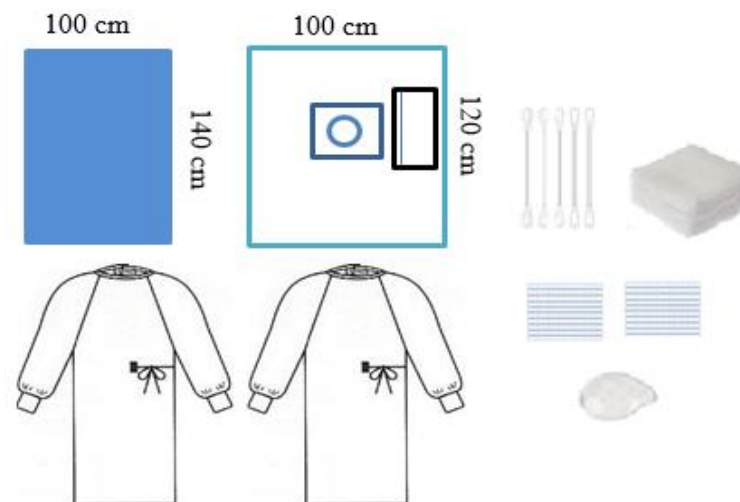

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222163	KIT CATARATA STANDARD	16

Esterilização
ETO

Validade
3 anos


Cadastro ANVISA
80166330067

89. KIT VITRECTOMIA

Indicação de Uso:

Indicado para os procedimentos de vitrectomia.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxíliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 100 cm x 140 cm.
- 02 – Aventais Cirúrgicos Tamanho G – Medida: 120 cm x 160 cm
- 01 – Avental Cirúrgico Tamanho XG – Medida: 135 cm x 175 cm
- 03 – Toalhas Absorventes
- 01 – Campo ciúrgico para oftalmo em SMS 40g/m² na medida de 160 cm x 200 cm com fenestra circular de 08 cm de diâmetro com adesivo hipoalergênico e bolsas laterais coletoras de fluídos.
- 05 – Campos Operatórios de algodão – medida: 45 cm x 50 cm.
- 02 – Cúpulas de Plástico com capacidade para 150 mL – Verdes
- 30 – Compressas de Gaze 13 fios na medida de 7,5 cm x 7,5 cm
- 20 – Hastes flexíveis de Algodão
- 01 – Oclutor ocular acrílico.
- 01 – Tampão Ocular

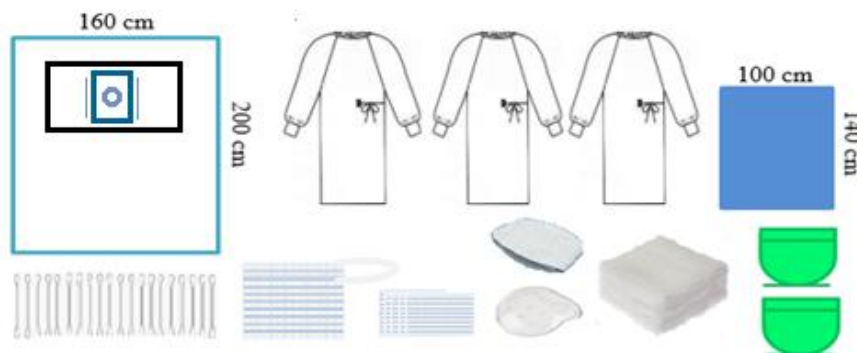

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222134	KIT VITRECTOMIA	08


Esterilização ETO	Validade 3anos	Regi. ANVISA 80166330052
----------------------	-------------------	-----------------------------

90. CAMPO CIRÚRGICO EM SMS ESTÉRIL PARA VITRECTOMIA COM BOLSA

Indicação de Uso:

Indicado para os procedimentos de vitrectomia.

- 01 – Campo ciúrgico para oftalmo em SMS 40g/m² na medida de 160 cm x 200 cm com fenestra circular de 08 cm de diâmetro com adesivo hipoalergênico e bolsa 360° com flexform coletora de fluídos.
- Dupla embalagem em invólucro em SMS 25g/m² e Papel Grau Cirúrgico.

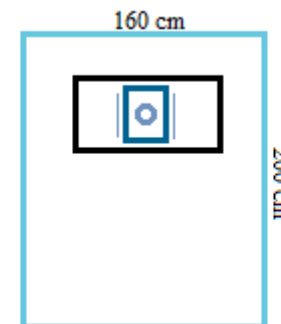

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
225267	CAMPO CIR. SMS P/ VITRECTOMIA C/BOLSA ESTÉRIL 160CMX200 CM	20


Esterilização ETO	Validade 3anos	Notificação ANVISA 80166330052
----------------------	-------------------	-----------------------------------

91. KIT PARA PUNÇÃO DE CATETER

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de passagem de Cateter Central e também para passagem de Cateter Central Inserção Periférica (PICC).

- 01 – Campo Impermeável de Mesa confeccionado em laminado plástico 48g/m² na medida de 130 cm x 200 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico Impermeável confeccionado em laminado plástico 48g/m² na medida de 65 cm x 80 cm.
- 01 - Campo Cirúrgico confeccionado em SMS 40g/m² na medida de 160 cm x 250 cm, com fenestra de 10 cm de diâmetro com reforço impermeável confeccionado em laminado 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica ao redor de toda a fenestra.
- 01 – Avental Cirúrgico STD Estéril G – Medida: 120 cm x 160 cm.
- 01 – Toalha Absorvente.

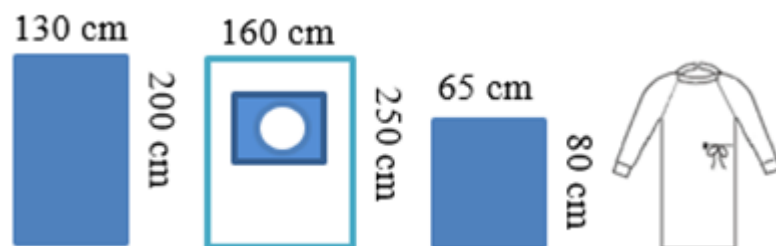

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222247	KIT PARA PUNÇÃO DE CATETER	16

Esterilização ETO	Validade 3anos	Notificação ANVISA 80166330050
----------------------	-------------------	-----------------------------------

92. KIT ANESTESIA

Indicação de Uso:

Indicado a auxiliar o profissional de saúde em procedimentos de anestesia.

- 01 – Curativo de Película Transparente 3M Tegaderm – Medida: 06 cm x 07 cm – Estéril
- 01 - Álcool Swab em Sachê – Não Estéril.
- 01 – Cateter Intravenoso - Estéril
- 05 – Compressas de Gaze 13 fios na medida de 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222131	KIT ANESTESIA	100


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
----------------------	--------------------	------------------------------

93. KIT APLICAÇÃO

Indicação de Uso:

Indicado a auxiliar o profissional de saúde em procedimentos cirúrgicos em geral.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 70 cm x 70 cm.
- 01 - Campo cirúrgico para oftalmo em SMS 40g/m² na medida de 75 cm x 75 cm com fenestra de 08 cm de diâmetro com adesivo.
- 10 - Compressas de Gaze 13 fios na medida de 7,5 cm x 7,5 cm.
- 05 - Hastes flexíveis de Algodão.

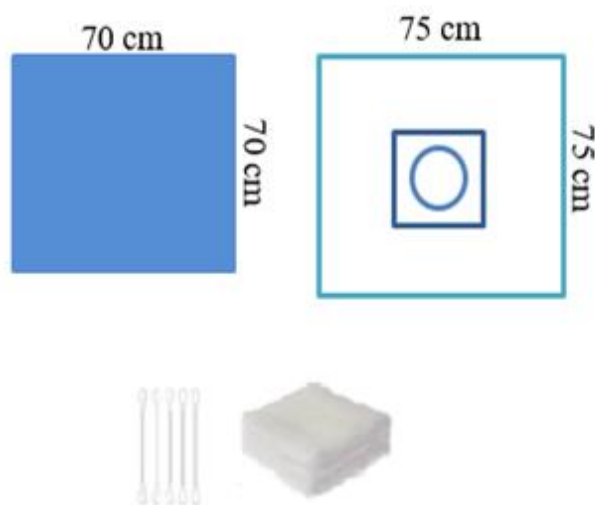


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
222133	KIT APLICAÇÃO	40
Esterilização ETO Validade 3anos Regi. ANVISA 80166330052		

94. CONJUNTO ESTÉRIL PARA RECEPÇÃO DE RECÉM-NASCIDO

Indicação de Uso: Indicado para recepção de recém nascido para utilização após o parto.

- 01 - Campo para Recém Nascido 100 cm x 100 cm, confeccionado em Laminado Branco Respirável 50g/m², com reforço em Não tecido Spuntec Branco na medida de 78 cm x 78 cm.
- 01 - Campo Hidrorepelente na medida de 150 cm x 100 cm confeccionado em Não tecido Spuntec Azul Hidrorepelente 70g/m², com reforço em PE Laminado Impermeável 26g/m² na medida de 130 cm x 100 cm.
- 01 - Touca para recém-nascido, confeccionada em algodão hipoalergênico, tamanho único, na cor branca.
- 04 - toalhas Absorventes 80 cm x 40 cm, confeccionadas em Spuntec Branco 50g/m².

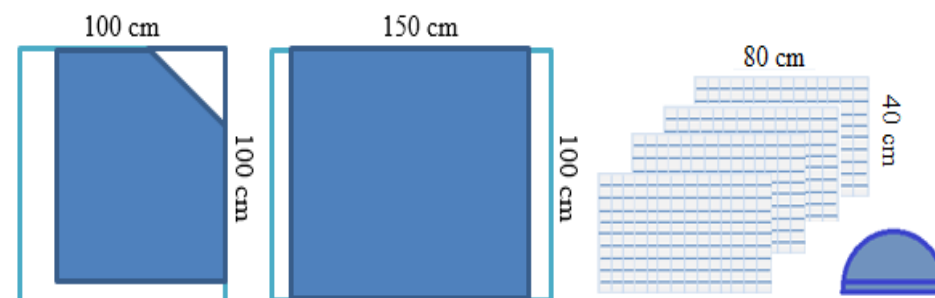


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222199	CONJUNTO ESTÉRIL P/ RECEPÇÃO DE RECEM-NASCIDO	15
Esterilização ETO Validade 3 anos Notificação ANVISA 80166330068		

95. KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Indicação de Uso: Indicado para profissionais que trabalham em serviços de saúde, no desenvolvimento de atividades em que exista risco eminente de contaminação por acidentes com respingos ou jatos de secreção, líquidos ou outros flúidos corpóreos.

- 01 – Avental para procedimento em laminado respirável/impermeável 50g/m², com punho de malha, na medida de 120 cm x 160 cm – Cor: Branca, com fechamento ajustável em tiras na altura do pescoço e tiras laterais para amarração na cintura.
- 01 – Touca descartável sanfonada branca 30g/m² - Medida: 2 cm x 20 cm
- 01 – Protetor Facial Health Quality – 21 cm x 32 cm.
- 01 – Campo Cir. SMS Laminado 80 cm x 65 cm
- 01 – Campo Cir. Fenestrado 06 cm na medida de 50 cm x 50 cm.

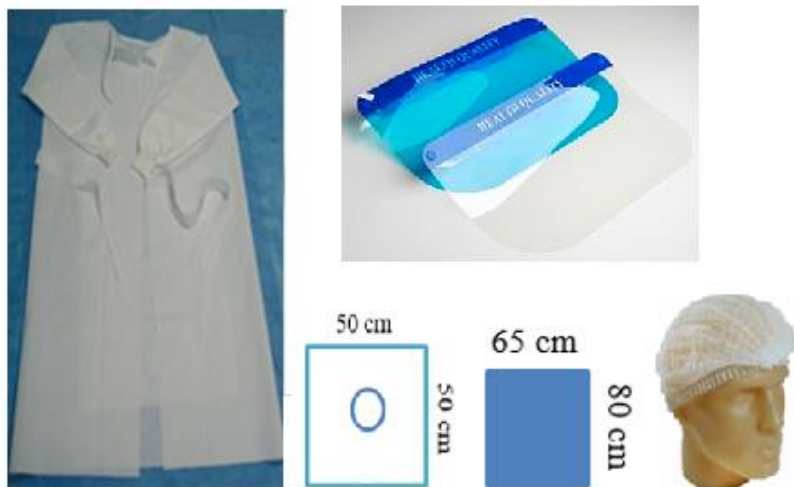

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
222162	KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	10			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização N/E</td><td>Validade 3 anos</td><td>Notificação ANVISA ISENTO</td></tr> </table>			Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO			

96. PERNEIRA DESCARÁVEL

Indicação de Uso:

Indicado para proteção parcial das pernas e calçados, dos profissionais que trabalham em serviços de saúde, no atendimento ao paciente ou no desenvolvimento de outras atividades em que exista risco eminente de contaminação, por acidentes com respingo ou jatos moderados dos seguintes produtos químicos: Ácido sulfúrico 30%; Hidróxido de sódio 10%; Butanol; Xileno.

- Perneira descartável confeccionada em Laminado respirável branco 50g/m², presença de laço com elástico na altura do tornozelo, elástico no final da perneira e duas tiras antiderrapantes na sola.
- A montagem da perneira é feita com solda ultrassônica, evitando vazamentos de líquidos no interior da perneira descartável.

Certificado de Aprovação (CA) nº 35504.

NORMA: ISO 16602: 2007 – Vestimentas Contra Riscos Químicos.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX			
299128	PERNEIRA DESCARTÁVEL C/ ANTI-DERRAPANTE	50			
<table border="1"> <tr> <td>Esterilização N/E</td><td>Validade 3 anos</td><td>Notificação ANVISA ISENTO</td></tr> </table>			Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO			

97. CONJUNTO ESTÉRIL I – BOS

Indicação de Uso: Indicado para utilização do profissional da saúde em procedimentos médicos. Uso único e individual.

- 01 – Máscara branca dupla descartável, com presença de cliques e elásticos – Medida: 17,3 cm x 9,3 cm.
- 01 – Touca descartável sanfonada branca 30g/m² - Medida: 2 cm x 20 cm
- 01 – Avental descartável 20g/m² com elástico e tiras para amarração – Medida: 140 cm x 110 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222170	CONJUNTO ESTÉRIL I – BOS	40

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
----------------------	--------------------	------------------------------

98. CONJUNTO ESTÉRIL II – BOS

Indicação de Uso: Indicado para utilização do profissional da saúde em procedimentos médicos. Uso único e individual.

- 01 – Máscara branca dupla descartável, com presença de cliques e elásticos – Medida: 17,3 cm x 9,3 cm.
- 01 – Touca descartável sanfonada branca 30g/m² - Medida: 2 cm x 20 cm
- 01 – Avental descartável 20g/m² com elástico e tiras para amarração – Medida: 140 cm x 110 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico confeccionado em laminado 48g/m² na medida de 50 cm x 50 cm com fenestra de 06 cm de diâmetro.
- 02 – Campos Cirúrgicos simples confeccionados em laminado 48g/m² na medida de 50 cm x 50 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222171	CONJUNTO ESTÉRIL II - BOS	30

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
----------------------	--------------------	------------------------------

99. TOALHA ABSORVENTE DE 30 CM X 37,5 CM

Indicação de Uso: Indicada para auxiliar na secagem de instrumentais, banho, para limpeza em geral.

- Toalha Absorvente Lisa confeccionada em Tecido 100% Viscose, com gramatura de 50g/m² ou 70g/m², na cor branca, na medida de 30 cm x 37,5 cm, embalada em saco plástico transparente confeccionado em polietileno atóxico.
- Toalha Absorvente Perfurada confeccionada em Tecido 70% Viscose e 30% Poliéster com gramatura de 50g/m², na cor branca, na medida de 30 cm x 37,5 cm, embalada em saco plástico transparente confeccionado em polietileno atóxico.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
212085	TOALHA ABSORVENTE PERFURADA 50 GR 30 X 37,5CM C/ 400 FOLHAS	400
212088	TOALHA ABSORVENTE LISA 70 GR 30 X 37,5CM C/ 400 FOLHAS	400
212087	TOALHA ABSORVENTE LISA 50 GR 30 X 37,5CM C/ 400 FOLHAS	400

Esterilização
N/E

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
ISENTO

100. TOALHA ABSORVENTE EM ROLO PICOTADA

Indicação de Uso: Indicada para auxiliar na secagem de instrumentais, banho e para limpeza em geral.

- Toalha Absorvente Lisa em Rolo Picotada confeccionada em Não Tecido 100% Viscose com gramatura de 70g/m² apresentada em rolo de 30 cm de largura x 225 metros de comprimento e toalhas picotadas na medida de 37,5 cm cada, com aproximadamente 600 toalhas de 37,5 cm x 30 cm por rolo.
- Disponibilizamos Dispenser de Parede.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
212089	TOALHA ABSORVENTE LISA 70 GR 30 cm X 225M ROLO PICOTADO	01

Esterilização
N/E

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
ISENTO

101. FORRO ABSORVENTE LISO

Indicação de Uso: Indicada para auxiliar na secagem de instrumentais e para limpeza em geral.

- Forro Absorvente Liso confeccionado em Não Tecido 100% Viscose, com gramatura de 50g/m² com baixo nível de despreendimento em fibras e alta capacidade de absorção. Absorve cinco vezes o seu peso em água.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CAIXA
212092	FORRO ABSORVENTE LISO 50 X 50 cm C/ 200 UND	200
212093	FORRO ABSORVENTE LISO 52 X 60 cm C/ 200 UND	200
212095	FORRO ABSORVENTE LISO 78 X 78CM C/ 200 UND	200
212096	FORRO ABSORVENTE LISO 100 X 100CM C/ 150 UND	150
212098	FORRO ABSORVENTE LISO 120 X 120CM C/ 100 UND	100

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA ISENTO
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

102. INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO LEVE

Embalagem do tipo Invólucro para Caixas/Pacotes de Esterilização, confeccionado em não-tecido SMS 40g/m² (leve) composto por 3 (três) camadas de polipropileno. A camada do meio (Meltblown) é composta por uma densa trama de microfibras que, embora permita a passagem de ar e agentes esterilizantes (Vapor, ETO, Peróxido de Hidrogênio e Formaldeído), é barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, partículas e microrganismos. Baixo Índice de Desprendimento de Fibras e/ou Partículas, reduzindo a disseminação de microrganismos e evitando a formação de granulomas.

- Apresenta-se na forma de folha simples ou folha dupla, com duas folhas soldadas eletronicamente facilitando a embalagem dos artigos que serão esterilizados, proporcionando maior segurança.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225142	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 40X40	600
225146	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 45X45	500
225042	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 50X50	600
225135	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 60X60	600
225043	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 75X75	350
225125	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 90X90	300
225045	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 100X100	250
225046	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 120X120	200
225139	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 50X50 FOLHA DUPLA	300
225147	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 75X75 FOLHA DUPLA	175
225257	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 90X90 FOLHA DUPLA	150
225036	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 100X100 FOLHA DUPLA	125
225152	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO LEVE 120X120 FOLHA DUPLA	100

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA Não se aplica.
-----------------------------	---------------------------	---

103. INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO PESADO

Embalagem do tipo Invólucro para Caixas/Pacotes de Esterilização, confeccionado em não-tecido SMS 50g/m² (pesado) composto por 3 (três) camadas de polipropileno. A camada do meio (Meltblown) é composta por uma densa trama de microfibras que, embora permita a passagem de ar e agentes esterilizantes (Vapor, ETO, Peróxido de Hidrogênio e Formaldeído), é barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, partículas e microrganismos. Baixo Índice de Desprendimento de Fibras e/ou Partículas, reduzindo a disseminação de microrganismos e evitando a formação de granulomas.

- Apresenta-se na forma de folha simples ou folha dupla, com duas folhas soldadas eletronicamente facilitando a embalagem dos artigos que serão esterilizados, proporcionando maior segurança.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225225	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 40X40	600
225086	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 50X50	500
225051	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 60X60	600
225102	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 75X75	350
225127	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 90X90	300
225103	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 100X100	250
225104	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 120X120	150
225210	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 150X150	100
225153	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 100X100 FOLHA DUPLA	100
225049	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 120X120 FOLHA DUPLA	100
225212	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 150X 150 FOLHA DUPLA	50
225155	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 60X60 FOLHA DUPLA	250
225154	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 75X75 FOLHA DUPLA	175
225141	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO 90X90 FOLHA DUPLA	150

Esterilização
N/E

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
Não se aplica.

104. INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO

Embalagem do tipo Invólucro para Caixas/Pacotes de Esterilização, confeccionado em não-tecido SMS 60g/m² (super pesado) composto por 3 (três) camadas de polipropileno. A camada do meio (Meltblown) é composta por uma densa trama de microfibras que, embora permita a passagem de ar e agentes esterilizantes (Vapor, ETO, Peróxido de Hidrogênio e Formaldeído), é barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, partículas e microrganismos. Baixo Índice de Desprendimento de Fibras e/ou Partículas, reduzindo a disseminação de microrganismos e evitando a formação de granulomas.

- Apresenta-se na forma de folha simples e folha dupla com duas folhas soldadas eletronicamente facilitando a embalagem dos artigos que serão esterilizados, proporcionando maior segurança.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225047	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO 50 CM X 50 CM	500
225136	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO 60 CM X 60 CM	500
225048	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO 75 CM X 75 CM	350
225137	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO 90 CM X 90 CM	300
225138	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO 100 CM X 100 CM	200
225140	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO SUPER PESADO 120 CM X 120 CM	150
225278	INVÓLUCRO P/ EST. S. PESADO 100 CM X 100 CM FOLHA DUPLA	100
225151	INVÓLUCRO P/ EST. S. PESADO 120 CM X 120 CM FOLHA DUPLA	75
225277	INVÓLUCRO P/ EST. S. PESADO 150 CM X 150 CM FOLHA DUPLA	50

Esterilização
N/E

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
Não se aplica.

105. INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO PESADO VERDE

Indicação de Uso:

Embalagem do tipo Invólucro para Caixas/Pacotes de Esterilização, confeccionado em não-tecido SMS 50g/m² (pesado) **na cor verde** composto por 3 (três) camadas de polipropileno. A camada do meio (Meltblown) é composta por uma densa trama de microfibras que, embora permita a passagem de ar e agentes esterilizantes (Vapor, ETO, Peróxido de Hidrogênio e Formaldeído), é barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, partículas e microrganismos. Baixo Índice de Desprendimento de Fibras e/ou Partículas, reduzindo a disseminação de microrganismos e evitando a formação de granulomas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
225253	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO VERDE 50 CM X 50 CM	500
225254	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO VERDE 75 CM X 75 CM	350
225258	INVÓLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO PESADO VERDE 100 CM X 100 CM	250

Esterilização N/E	Validade 3 anos	Notificação ANVISA Não se aplica.
-----------------------------	---------------------------	---

106. TUBULARES PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP

Os Tubulares para Esterilização Health Quality foram projetados para embalar materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais que necessitem passar por processo de esterilização, proporcionando eficácia e segurança neste processo. São compostos por uma estrutura dupla, onde um dos lados é formado por filme laminado de poliéster com polipropileno e o outro por um papel especial denominado grau cirúrgico, que permite com que o agente esterilizante permeie sua superfície sem que o mesmo ocorra com os microrganismos contaminantes. A embalagem oferece marcador visual, que tem por função sinalizar a passagem pelo processo de esterilização, por meio da mudança de cor.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
256006	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 60 MM X 100 M
256007	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 80 MM X 100 M
256001	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 100 M X 100 M
256008	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 120 MM X 100 M
256002	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 150 MM X 100 M
256003	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 200 MM X 100 M
256004	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 250 MM X 100 M
256009	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 300 MM X 100 M
256005	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 350 MM X 100 M
256010	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 400 MM X 100 M
256011	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 450 MM X 100 M
256012	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 500 MM X 100 M
256013	TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 600 MM X 100 M

Esterilização Não Estéril	Validade 2 anos	Notificação ANVISA Não se aplica.
-------------------------------------	---------------------------	---

107. ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP

Os Envelopes para Esterilização Health Quality foram projetados para embalar materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais que necessitem passar por processo de esterilização, proporcionando eficácia e segurança neste processo. São compostos por uma estrutura dupla, onde um dos lados é formado por filme laminado de poliéster com polipropileno e o outro por um papel especial denominado grau cirúrgico, que permite com que o agente esterilizante permeie sua superfície sem que o mesmo ocorra com os microorganismos contaminantes. A embalagem oferece marcador visual, que tem por função sinalizar a passagem pelo processo de esterilização, por meio da mudança de cor.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
256014	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 80 MM X 250 MM
256015	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 100 MM X 150 MM
256016	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 100 MM X 250 MM
256017	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 100 MM X 550 MM
256018	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 120 MM X 270 MM
256019	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 150 MM X 160 MM
256020	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 150 MM X 200 MM
256021	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 150 MM X 270 MM
256022	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 150 MM X 350 MM
256023	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 180 MM X 300 MM
256024	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 200 MM X 250 MM
256025	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 200 MM X 400 MM
256026	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 250 MM X 300 MM
256027	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 250 MM X 350 MM
256028	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 300 MM X 450 MM
256029	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 300 MM X 500 MM
256030	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PET/PP 450 MM X 600 MM

Esterilização Não Estéril	Validade 2 anos	Notificação ANVISA Não se aplica.
-------------------------------------	---------------------------	---

108. CONJUNTO ACESSO SONDAGEM

Indicação de Uso: Indicado para procedimentos cirúrgicos de sondagem vesical.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 70 cm x 70 cm.
- 01 – Campo Cirúrgico em SMS 50g/m² com fenestra de 16 cm de diâmetro – Medida de 50 cm x 50 cm (Conjunto Acesso Sondagem I) ou 40 cm x 40 cm (Conjunto Acesso Sondagem II)
- 01 - Pinça Cherron 24,5 cm - Branca.
- 01 – Cúpula de Plástico com capacidade para 150 mL
- 07 – Compressas de Gaze 13 fios na medida de 7,5 cm x 7,5 cm s/ RX.

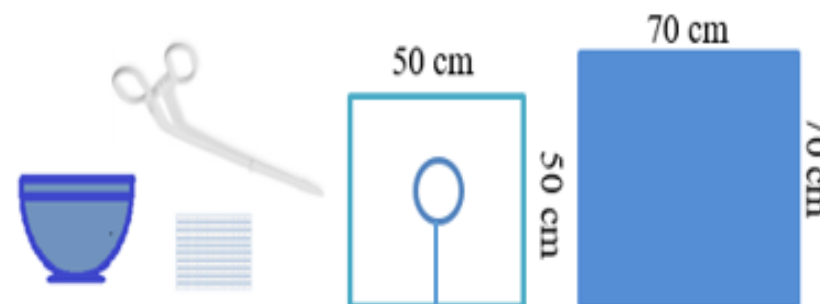

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222078	CONJUNTO ACESSO SONDAGEM I	50
222079	CONJUNTO ACESSO SONDAGEM II (alteração na med. do campo)	20

Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330059
-----------------------------	---------------------------	--


109. CONJUNTO IDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos de hemodinâmica onde é necessário a diferenciação de líquidos, devido aos mesmos serem incolores, evitando a inversão na utilização destes.

- 01 – Campo Cirúrgico Laminado 48g/m² 75 cm x 75 cm – Azul
- 01 – Cuba Rim Branca – Capacidade 500 mL
- 01 – Cúpula Amarela – Capacidade 150 mL
- 01 – Cúpula Verde – Capacidade 150 mL
- 01 – Cúpula Vermelha – Capacidade 150 mL
- 01 – Pinça Cherron 24,5 cm - Branca

Obs: A Cuba Rim, e as três cúpulas coloridas possuem fita dupla face colada no fundo, para melhor fixação no campo durante o procedimento.

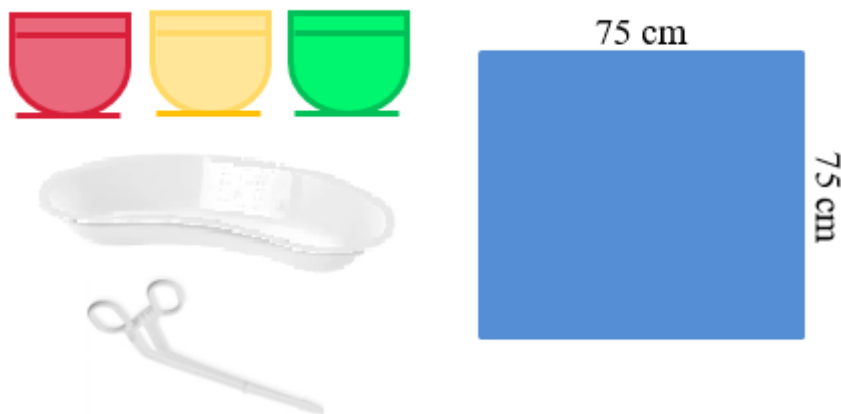

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222085	CONJUNTO IDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES	12


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330062
-----------------------------	---------------------------	--

110. CONJUNTO ACESSO SONDAÇÃO VESICAL

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos cirúrgicos de sondagem vesical, proporcionando um campo cirúrgico estéril, limpo e seco, além de proporcionar uma região isolada e livre de partículas ou líquidos.

- 01 – Campo Cirúrgico Laminado 48g/m² 80 cm x 80 cm – Azul
- 01 – Campo SMS 50g/m² 75 cm x 75 cm Fenestrado 10 cm - Azul
- 01 – Cuba Rim Branca – Capacidade 500 mL
- 01 – Cúpula Amarela – Capacidade 150 mL
- 01 – Pinça Cherron 24,5 cm – Branca
- 07 – Compressas Gaze 7,5 cm x 7,5 cm costuradas nas pontas

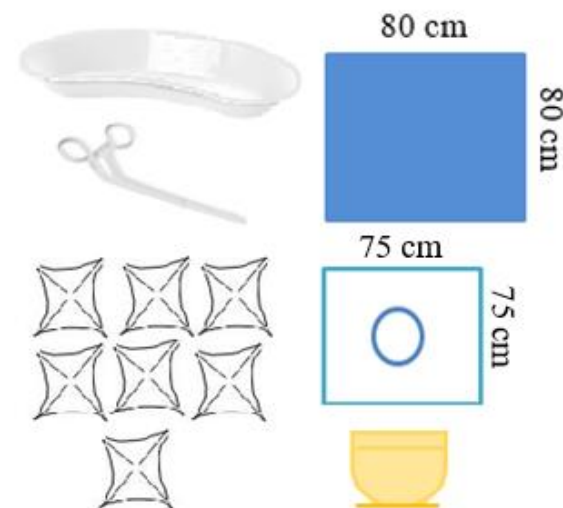

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222237	CONJUNTO ACESSO SONDAÇÃO VESICAL	50


Esterilização ETO	Validade 3 anos	Notificação ANVISA 80166330059
-----------------------------	---------------------------	--

111. CONJUNTO ACESSO SONDAGEM POR IMAGEM

Indicação de Uso:

Indicado para procedimentos setor de imagens.

- 01 - Campo Cirúrgico Para Mesa Auxiliar em laminado plástico 48g/m² - Medidas: 130 cm x 200 cm.
- 01 - Campo cirúrgico em SMS 50g/m² na medida de 100 cm x 100 cm, com janela de 10 cm, reforço impermeável 55g/m² e fita adesiva hipoalergênica.
- 01 - Protetor de agulha em E.V.A na medida de 04 cm x 06 cm.
- 01 - Cuba Rim Branca – Capacidade 500 mL
- 01 - Cúpula Amarela – Capacidade 150 mL
- 01 - Cúpula Verde - Capacidade 150 mL
- 01 - Pinça Cherron 24,5 cm – Branca
- 40 - Compressas de Gaze 13 fios na medida de 7,5 cm x 7,5 cm.

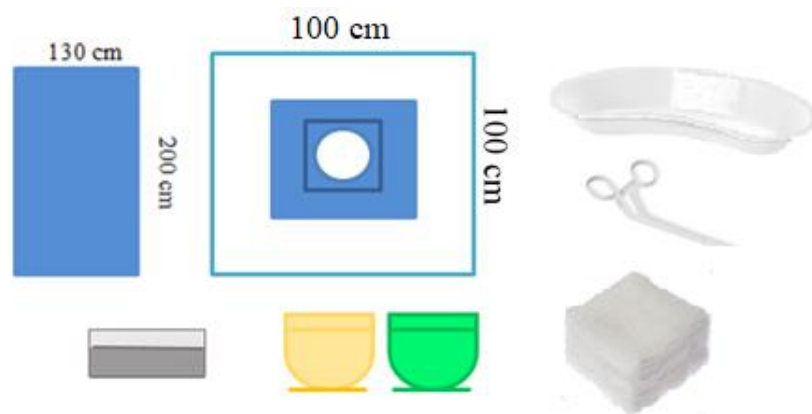

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
222233	CONJUNTO ACESSO SONDAGEM POR IMAGEM	03

Esterilização
ETO

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
80166330059

112. BOLSA PLÁSTICA PARA CONTAR CAMPOS E COMPRESSAS

Indicação de Uso:

Indicadas para utilização em Hamper para a contagem de campos e compressas durante os procedimentos cirúrgicos. Cada cor é responsável pelo descarte de uma categoria de produto. Bolsas confeccionadas em Plástico (Amarelo, Verde ou Azul) 0,005 mm de espessura, na medida de 100 cm x 54 cm soldado em plástico transparente 0,005 mm de espessura na medida de 24 cm x 54 cm. Medida final das bolsas: 91 cm x 54 cm. Possui 06 divisórias de 23 cm x 23,5 cm.

INDICAÇÕES:

- Bolsa central transparente
- Bolsa Amarela: campo operatório Pequeno 30 cm x 30 cm
- Bolsa Azul: Campo Operatório Grande 45 cm x 45 cm
- Bolsa Verde: Compressas 7,5 cm x 7,5 cm

OBS: Hamper disponibilizado em comodato pela Health Quality.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITENS/CX
204094	BOLSA PLÁST. AMARELA P/ CONTAR CAMPO OPERATÓRIO 30CMX30CM	50
204095	BOLSA PLÁST. AZUL P/ CONTAR CAMPO OPERATÓRIO 45CMX45CM	50
204096	BOLSA PLÁST. VERDE P/ CONTAR COMPRESSA GAZE 7,5CMX7,5CM	50
204097	BOLSA PARA HAMPER COM ELÁSTICO C/ 10 UNIDADES (BOLSA CENTRAL)	100

Esterilização
N/E

Validade
3 anos

Notificação ANVISA
Isento

